




La traçabilité complète
de la stérilisation



Quitter



Imprimer la
Fiche du cycle



Imprimer les étiquettes
des Articles



Re-stérilisation
d'articles périmés



Import de
fichiers



Recherches
Historique



Aide

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation
Instrument	ARRACHE COURONNE
Instrument	CISEAU
Instrument	CISEAUX A SUTURES
Instrument	CONTRE ANGLE BLEU
Instrument	CONTRE ANGLE ROUGE
Instrument	CONTRE ANGLE VERT
Instrument	CURETTE
Instrument	DAVIER BAS ENFANT
Instrument	DAVIER BAS INCISIVE
Instrument	DAVIER BAS MOLAIRE
Instrument	DAVIER BAS PREMOLAIRE
Instrument	DAVIER BAS RACINE
Instrument	DAVIER HAUT ENFANT COURBE
Instrument	DAVIER HAUT ENFANT DROIT
Instrument	DAVIER HAUT INCISIVE
Instrument	DAVIER HAUT MOLAIRE
Instrument	DAVIER HAUT PREMOLAIRE
Instrument	DAVIER HAUT RACINE
Instrument	ELEVATEUR COURBE
Instrument	ELEVATEUR COURBE FIN
Instrument	ELEVATEUR COURBE LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT FIN
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE COURT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE GAUCHE
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DET
Regroupement	KIT ENDO
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SOINS
Instrument	MANCHE SCALPEL

Liste des stérilisations

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
05/04/2017	18:27	Cycle de stérilisation	000 000 419	
29/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	000 000 418	
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	000 000 417	
20/02/2017	14:39	Cycle de stérilisation	000 000 416	
06/02/2017	11:43	Cycle de stérilisation	000 000 415	
30/01/2017	14:54	Cycle de stérilisation	000 000 414	
24/01/2017	17:36	Cycle de stérilisation	000 000 413	
17/01/2017	15:37	Cycle de stérilisation	000 000 412	
05/01/2017	18:26	Cycle de stérilisation	000 000 411	
20/12/2016	15:28	Cycle de stérilisation	000 000 410	
14/12/2016	13:21	Cycle de stérilisation	000 000 409	
17/11/2016	11:39	Cycle de stérilisation	000 000 408	
09/11/2016	15:45	Cycle de stérilisation	000 000 407	
27/10/2016	16:54	Cycle de stérilisation	000 000 406	
13/10/2016	14:36	Cycle de stérilisation	000 000 405	

Créer un cycle Modifier le cycle Invalider le cycle Supprimer le cycle

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Fenêtre principale

Complément :

Documents : 420.pdf


8 articles contenus dans le cycle

Désignation	Número	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date
<input type="checkbox"/>	SYNDESMOTOME CHOM	000 000 419 001	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE	
<input type="checkbox"/>	SYNDESMOTOME CHOM	000 000 419 002	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE	
<input checked="" type="checkbox"/>	SYNDESMOTOME CHOM	000 000 419 003	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE	

Créer Modifier Supprimer

Traçabilité simplifiée

Traçabilité complète



Quitter



Imprimer la
Fiche du cycle



Imprimer les étiquettes
des Articles



Re-stérilisation
d'articles périmés



Import de
fichiers



Recherches
Historique



Aide

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation
Instrument	ARRACHE COURONNE
Instrument	CISEAU
Instrument	CISEAUX A SUTURES
Instrument	CONTRE ANGLE BLEU
Instrument	CONTRE ANGLE ROUGE
Instrument	CONTRE ANGLE VERT
Instrument	CURETTE
Instrument	DAVIER BAS ENFANT
Instrument	DAVIER BAS INCISIVE
Instrument	DAVIER BAS MOLLAIRE
Instrument	DAVIER BAS PREMOLAIRE
Instrument	DAVIER BAS RACINE
Instrument	DAVIER HAUT ENFANT COURBE
Instrument	DAVIER HAUT ENFANT DROIT
Instrument	DAVIER HAUT INCISIVE
Instrument	DAVIER HAUT MOLLAIRE
Instrument	DAVIER HAUT PREMOLAIRE
Instrument	DAVIER HAUT RACINE
Instrument	ELEVATEUR COURBE
Instrument	ELEVATEUR COURBE FIN
Instrument	ELEVATEUR COURBE LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT FIN
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE COURT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE GAUCHE
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DET
Regroupement	KIT ENDO
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SOINS
Instrument	MANCHE SCALPEL

Créer

Modifier

Supprimer

Traçabilité simplifiée

Liste des stérilisations

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
05/04/2017	18:27	Cycle de stérilisation	000 000 419	
29/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	000 000 418	
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	000 000 417	
20/02/2017	14:39	Cycle de stérilisation	000 000 416	
06/02/2017	11:43	Cycle de stérilisation	000 000 415	
30/01/2017	14:54	Cycle de stérilisation	000 000 414	
24/01/2017	17:36	Cycle de stérilisation	000 000 413	
17/01/2017	15:37	Cycle de stérilisation	000 000 412	
05/01/2017	18:26	Cycle de stérilisation	000 000 411	
20/12/2016	15:28	Cycle de stérilisation	000 000 410	
14/12/2016	13:21	Cycle de stérilisation	000 000 409	
17/11/2016	11:39	Cycle de stérilisation	000 000 408	
09/11/2016	15:45	Cycle de stérilisation	000 000 407	
27/10/2016	16:54	Cycle de stérilisation	000 000 406	
13/10/2016	14:36	Cycle de stérilisation	000 000 405	

Créer un cycle

Modifier le cycle

Invalider le cycle

Supprimer le cycle

Opérateur : NC

Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle: Cycle de stérilisation







Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Il est nécessaire de créer la liste de l'ensemble des instruments et regroupements d'instruments susceptibles d'être stérilisés

Designation	Numero	Emballage	Peremption	Utilise pour	Praticien	Date
<input type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOM	000 000 419 001	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOM	000 000 419 002	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE		
<input checked="" type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOM	000 000 419 003	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE		
<input checked="" type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOM	000 000 419 004	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> ELEVATEUR DROIT LAR	000 000 419 005	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE		

Dans la partie supérieure une barre d'icônes

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI



⇒ L'aide en ligne

The screenshot shows a help window titled 'Aide de LOGOS_w'. On the left is a table of contents with 'Traçabilité de la stérilisation' selected. The main content area is titled 'Traçabilité de la stérilisation' and contains the following text:

Ce module vous permet de façon simple de répondre à vos obligations en matière de stérilisation. Les articles stérilisés seront désormais parfaitement tracés. Le temps nécessaire à la saisie des données et au transfert vers les fiches patients est réduit au minimum.

Une douchette-lecteur de codes-barres (format du code 128) et une imprimante à étiquettes vous faciliteront encore la tâche. Un simple bip de douchette sur le code-barre du sachet utilisé au fauteuil suffit dans le dossier du patient en cours pour ouvrir la fenêtre de traçabilité et la renseigner.

Ce module peut être lancé par C:\wlogos\1sterilisation.exe. Il existe un icône de raccourci représentant des ondes bleues de vapeur d'eau : menu "Outils" "Profils utilisateurs" barre d'icônes, ajout de l'icône "stérilisation".

La fenêtre principale de ce module est composée de deux parties gauche et droite. Un split vertical entre ces deux zones vous permet d'en optimiser l'affichage.

- La partie gauche vous offre au choix deux interfaces de traçabilité : simplifiée ou complète. La différence entre ces deux formules réside essentiellement dans la différenciation des instruments. Un clic sur l'une des deux barres de choix vous ouvre le volet correspondant.

En **traçabilité simplifiée**: ce volet de gauche comporte uniquement le nombre d'articles présents dans le cycle et la durée de validité de la stérilisation.

En **traçabilité complète**: il est nécessaire de créer la liste de l'ensemble des instruments et regroupements d'instruments susceptibles d'être stérilisés. Pour ce faire, il faut utiliser les boutons "Créer", "Modifier" ou "Supprimer" situés à la partie inférieure du volet. Pour créer un instrument, il faut cocher "instrument" puis renseigner sa désignation, son fabricant, sa famille, les actes pour lesquels il est utilisé, le type d'emballage de stérilisation utilisé, la durée de validité de la stérilisation. Si vous exercez à plusieurs, il peut être également intéressant de renseigner quel praticien est susceptible d'utiliser l'instrument et dans quelle(s) salle(s) il peut être. Vous pouvez également associer à l'instrument une photo si vous en possédez une.

Lorsque les instruments unitaires stérilisables ont été renseignés, il est possible de créer des regroupements d'instruments, c'est à dire des instruments stérilisés dans le même contenant (boîte, tub, plateau, etc). Pour ce faire, cochez "regroupements d'instruments" puis dans la table "désignation des articles", double cliquez sur chacun des instruments faisant l'objet du regroupement. Il est également nécessaire de renseigner sa désignation, les actes pour lesquels il est utilisé, le type d'emballage de stérilisation utilisé, la durée de validité de la stérilisation. Si vous exercez à plusieurs, il peut être également intéressant de renseigner quel praticien est susceptible d'utiliser le regroupement d'instruments et dans quelle(s) salle(s) il peut être. Vous pouvez également associer à ce regroupement une photo si vous en possédez une.

- La partie droite permet de gérer l'ensemble des cycles de stérilisation. Sa partie supérieure comporte la "Liste des stérilisations" qui peut être triée par ordre de date (ou ordre inverse).

Pour créer un cycle, cliquez sur le bouton situé directement au-dessous. Dans tous les cas, il est nécessaire de renseigner l'opérateur (ses initiales), le nom du stérilisateur, le type de cycle (de stérilisation ou de test), le mode de stérilisation (vapeur-Plions 134°C 18 mn, vapeur-Plastique 121°, 20 mn, etc.) ensuite la date et

L'interface "traçabilité complète"

- ⇒ Nécessite la saisie préalable de tous les instruments stérilisables du cabinet
- ⇒ Il va donc falloir en premier, établir le stock d'instruments à stériliser

L'interface "traçabilité complète"

⇒ On saisit d'abord les instruments seuls, un par un, que l'on pourra ensuite réunir dans des "regroupements" qui correspondent à nos boîtes, cassettes, voire simplement aux instruments qui sont stérilisés systématiquement ensemble, dans le même sachet (kit d'examen par exemple)

⇒ Il faut une liste complète et exhaustive de TOUS les instruments que l'on stérilise

⇒ Instruments de chirurgie.....

⇒ Instruments d'ODF

⇒ Instruments d'implantologie

⇒ Instruments d'endodontie

⇒ Instruments de prothèse

⇒ Instruments de parodontologie

Création de chaque article

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Imprimer la Fiche du cycle Imprimer les étiquettes des Articles Re-stérilisation d'articles périmés Import de fichiers Recherches Historique Aide

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation
Instrument	ARRACHE COURONNIE
Instrument	CISEAU
Instrument	CISEAUX A SUTURES
Instrument	CONTRE ANGLE BLEU
Instrument	CONTRE ANGLE ROUGE
Instrument	CONTRE ANGLE VERT
Instrument	CURETTE
Instrument	DAVIER BAS ENFANT
Instrument	DAVIER BAS INCISIVE
Instrument	DAVIER BAS MOLAIRE
Instrument	DAVIER BAS PREMOLAIRE
Instrument	DAVIER BAS RACINE
Instrument	DAVIER HAUT ENFANT COURBE
Instrument	DAVIER HAUT ENFANT DROIT
Instrument	DAVIER HAUT INCISIVE
Instrument	DAVIER HAUT MOLAIRE
Instrument	DAVIER HAUT PREMOLAIRE
Instrument	DAVIER HAUT RACINE
Instrument	ELEVATEUR COURBE
Instrument	ELEVATEUR COURBE FIN
Instrument	ELEVATEUR COURBE LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT FIN
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE COURT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE GAUCHE
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DET
Regroupement	KIT ENDO
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SOINS
Instrument	MANCHE SCALPEL

Créer Modifier Supprimer

Traçabilité simplifiée

Liste des stérilisations

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
05/04/2017	18:27	Cycle de stérilisation	000 000 419	
29/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	000 000 418	
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	000 000 417	
20/02/2017	14:39	Cycle de stérilisation	000 000 416	
06/02/2017	11:43	Cycle de stérilisation	000 000 415	
30/01/2017	14:54	Cycle de stérilisation	000 000 414	
24/01/2017	17:36	Cycle de stérilisation	000 000 413	
17/01/2017	15:37	Cycle de stérilisation	000 000 412	
05/01/2017	18:26	Cycle de stérilisation	000 000 411	
20/12/2016	15:28	Cycle de stérilisation	000 000 410	
14/12/2016	13:21	Cycle de stérilisation	000 000 409	
17/11/2016	11:39	Cycle de stérilisation	000 000 408	
09/11/2016	15:45	Cycle de stérilisation	000 000 407	
27/10/2016	16:54	Cycle de stérilisation	000 000 406	
13/10/2016	14:36	Cycle de stérilisation	000 000 405	

Créer un cycle Modifier le cycle Invalider le cycle Supprimer le cycle

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode: Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date: 05/04/2017 Heure: 18:27

N° de cycle: 000 000 419 Référence:

Complément:

Documents : 420.pdf

8 articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date
<input type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOM	000 000 419 001	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOM	000 000 419 002					
<input checked="" type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOM	000 000 419 003					
<input checked="" type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOM	000 000 419 004					
<input type="checkbox"/> ELEVATEUR DROIT LAR	000 000 419 005					

Clic sur "Créer"

Création de chaque article

⇒ La case instrument est cochée (par défaut)

Quitter Imprimer la Fiche du cycle Imprimer les étiquettes des Articles

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation
<input checked="" type="checkbox"/>	ARRACHE COURONNE
<input checked="" type="checkbox"/>	CISEAU
<input checked="" type="checkbox"/>	CISEAUX A SUTURES
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRE ANGLE BLEU
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRE ANGLE ROUGE
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRE ANGLE VERT
<input checked="" type="checkbox"/>	CURETTE
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVIER BAS ENFANT
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVIER BAS INCISIVE
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVIER BAS MOLAIRE
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVIER BAS PREMOLAIRE
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVIER BAS RACINE
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVIER HAUT ENFANT COURBE
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVIER HAUT ENFANT DROIT
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVIER HAUT INCISIVE
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVIER HAUT MOLAIRE

Instrument Regroupement d'instruments

Photo :

Fabricant :

Famille :

Utilisé pour :

Emballage :

Péremption : jours

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ok Annuler Dupliquer

Traçabilité simplifiée

Création de chaque article

- ⇒ **Désignation** : nom de l'instrument (pas de lettres en minuscules)
- ⇒ Chiffres et symboles (tirets etc...) possibles

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation :

Photo :

Fabricant :

Famille :

Utilisé pour :

Emballage :


Péréemption : jours

Praticien :





Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

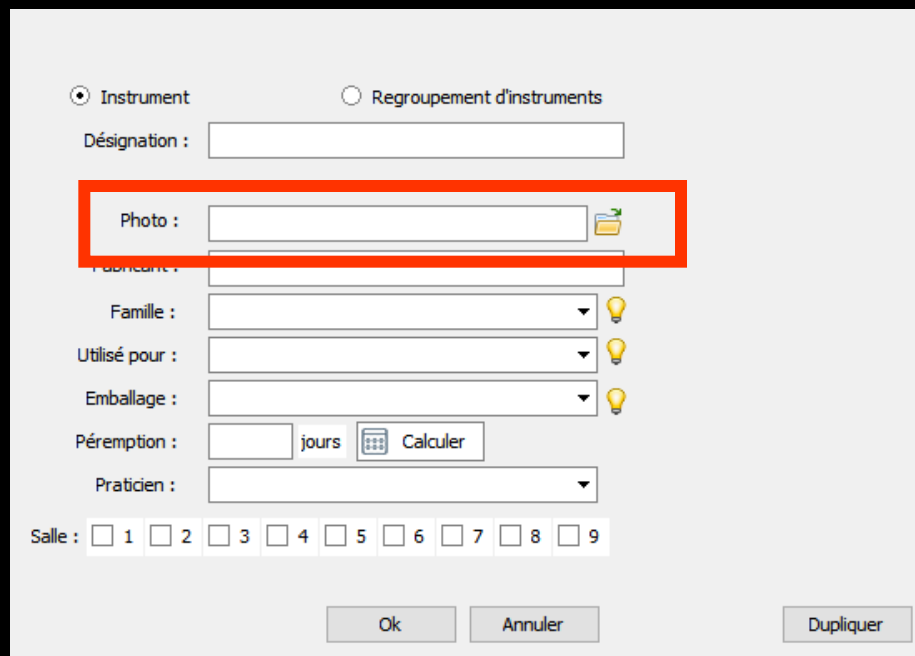Création de chaque article

⇒ **Photo** : possibilité en cliquant sur le petit classeur à droite d'y associer une photo mise dans un répertoire du disque dur





The screenshot shows a software interface for creating an article. It features several input fields and buttons. The 'Photo' field is highlighted with a red box, and a small folder icon is visible to its right. The interface includes the following elements:

- Radio buttons for 'Instrument' (selected) and 'Regroupement d'instruments'.
- Text input field for 'Désignation :'.
- Text input field for 'Photo :'.
 
- Text input field for 'Fabricant :'.
- Dropdown menu for 'Famille :'.
 
- Dropdown menu for 'Utilisé pour :'.
 
- Dropdown menu for 'Emballage :'.
 
- Text input field for 'Péréemption :'.
 jours
- Dropdown menu for 'Praticien :'.
- Radio buttons for 'Salle : 1' through '9'.
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Buttons for 'Ok', 'Annuler', and 'Dupliquer'.



⇒ Lien vers un fichier externe

- ⇒ Les photos mises dans un répertoire sont atteintes par le petit classeur
- ⇒ Possibilité de zoomer
- ⇒ Le stockage se fait par copie dans `\wlogos2\patients\ster\photos`

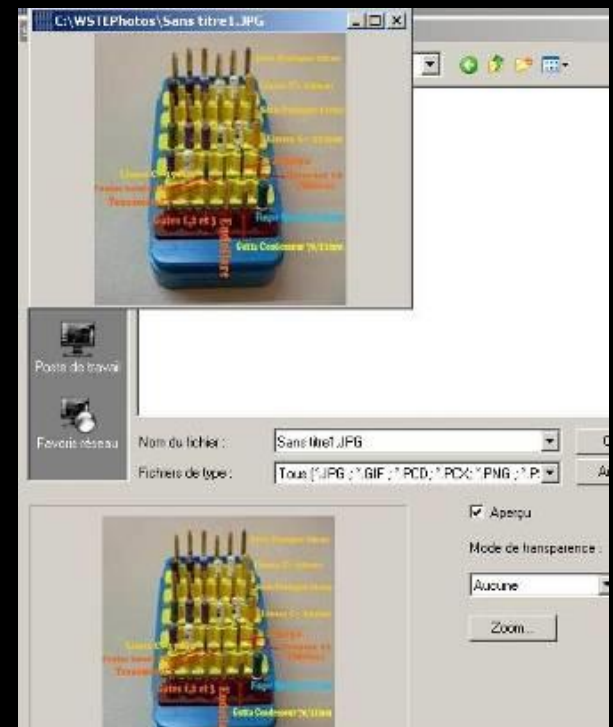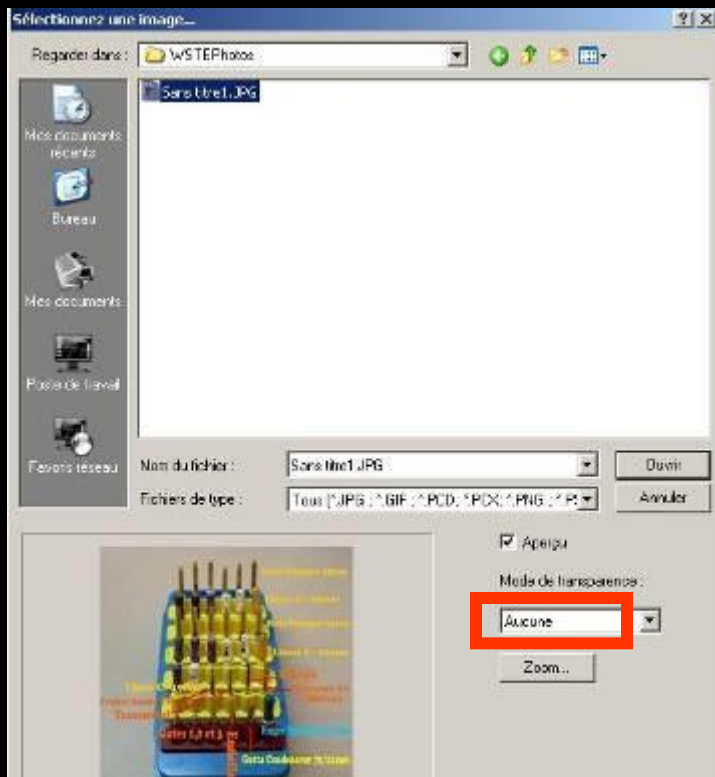

Création de chaque article

⇒ **Fabricant** : case à remplissage facultatif

The screenshot shows a form for creating an article. At the top, there are two radio buttons: "Instrument" (selected) and "Regroupement d'instruments". Below this are several input fields and dropdown menus:

- Désignation : [text input]
- Photo : [text input with image icon]
- Fabricant : [text input]** (highlighted with a red box)
- Famille : [text input with lightbulb icon]
- Utilisé pour : [dropdown menu with lightbulb icon]
- Emballage : [dropdown menu with lightbulb icon]
- Péremption : [text input] jours [Calculer button]
- Praticien : [dropdown menu]
- Salle : [checkbox 1] [checkbox 2] [checkbox 3] [checkbox 4] [checkbox 5] [checkbox 6] [checkbox 7] [checkbox 8] [checkbox 9]

At the bottom, there are three buttons: "Ok", "Annuler", and "Dupliquer".

Création de chaque article

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation :

Photo :

Fabricant :

Famille :

Utilisé pour :

Péréemption : jours

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Familles d'utilisation des matériaux

ANESTHESIE
CHIRURGIE
DIVERS
ENDODONTIE
IMPLANTOLOGIE
ODF
PARODONTOLOGIE
PROTHESE
RADIO
SOINS CONSERVATEURS
STERILISATION-HYGIENE

⇒ **Utilisé pour** : à remplir de préférence

⇒ Un clic sur l'ampoule jaune à droite de "Utilisé pour" permet de créer les familles d'utilisation des produits (par défaut on retrouve les mêmes familles créées pour les matériaux)

Création de chaque article

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation :

Photo :

Fabricant :

Famille :

Utilisé pour :

Péréemption : jours

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Familles d'utilisation des matériaux

ANESTHESIE
CHIRURGIE
DIVERS
ENDODONTIE
IMPLANTOLOGIE
ODF
PARODONTOLOGIE
PROTHESE
RADIO
SOINS CONSERVATEURS
STERILISATION-HYGIENE

⇒ **Utilisé pour** : à remplir de préférence

⇒ Mais comme pour "Matéριοvigilance et stock" à chacun de bien choisir les familles d'utilisation des matériaux (les types d'actes de la nomenclature par exemple endo, prothèse, paro etc...)

Création de chaque article

Instrument / Regroupement d'instruments

Désignation :

Photo :

Fabricant :

Famille :

Utilisé pour :

Échelle :

Péréemption : jours

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Familles d'utilisation des matériaux

ANESTHESIE
CHIRURGIE
DIVERS
ENDODONTIE
IMPLANTOLOGIE
ODF
PARODONTOLOGIE
PROTHESE
RADIO
SOINS CONSERVATEURS
STERILISATION-HYGIENE

- ⇒ Pour des choix multiples pour des instruments polyvalents
- ⇒ Si on ne met rien dans la case "Utilisé pour" pour un article il sera systématiquement proposé pour tous les actes

Intérêt de remplir "Utilisé pour"

- ⇒ Si on rentre un acte de prothèse
- ⇒ En triant par utilisation, seuls les articles de prothèse seront présentés au choix
- ⇒ **Le tri par utilisation** ne laissera apparaître que les instruments spécifiques aux types d'actes de la séance + les articles sans usage précis (sans rien dans la case utilisé pour)

Création de chaque article

- ⇒ **Emballage** : à remplir
- ⇒ Un clic sur l'ampoule à droite du champ "Emballage" permet de créer les types d'emballage utilisés
- ⇒ Pour la création d'un nouveau type d'emballage (par défaut : boîte, sachet, plateau) une fenêtre de confirmation après création sur la ligne

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation :

Photo :

Fabricant :

Famille :

Utilisé pour :

Emballage :

Désignation : jours

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Types d'emballages utilisés

BOITTE,SACHET,PLATEAU

SACHET

Utilisé pour :

Emballage : TRAY

Désignation : jours

Stérilisation LOGOS_w - Docteur Ninon CREMONINI

Confirmez-vous la création de ce type d'emballage?

Création de chaque article


⇒ **Péremption (en jours)** : à remplissage obligatoire pour savoir quand restériliser du matériel non utilisé et dont la date de péremption arrive à échéance

⇒ La date de péremption en jours sera fonction du type d'emballage utilisé


The screenshot shows a software interface for creating an instrument article. It features two radio buttons at the top: 'Instrument' (selected) and 'Regroupement d'instruments'. Below are several input fields: 'Désignation', 'Photo' (with a photo icon), 'Fabricant', 'Famille' (with a dropdown arrow and lightbulb icon), 'Utilisé pour' (with a dropdown arrow and lightbulb icon), and 'Emballage' (with a dropdown arrow and lightbulb icon). The 'Péremption' field is highlighted with a red box and contains a text input, the word 'jours', and a 'Calculer' button. Below this is a 'Praticien' dropdown menu. At the bottom, there is a 'Salle' section with checkboxes for rooms 1 through 9, and three buttons: 'Ok', 'Annuler', and 'Dupliquer'.


Instrument Regroupement d'instruments


Désignation :


Photo : 

Fabricant :

Famille : 

Utilisé pour : 



Emballage : 

Péremption : jours  Calculer

Pratiken :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Durée de la stérilisation

 Annuler  Ok

Source : afs.asso.fr
Il vous appartient de vérifier l'exactitude des informations auprès de vos fabricants des matériels utilisés pour la stérilisation

Protecteur individuel de stérilité

Emballage de protection

Moyen de stockage

Lieu de stockage

Péremption à
1 an
(à titre indicatif, selon AFNOR FDS 98-135)

⇒ Aide pour calculer la durée de stérilisation

Durée de la stérilisation [X]

Source : afs.asso.fr
Il vous appartient de vérifier l'exactitude des informations auprès de vos fabricants des matériels utilisés pour la stérilisation

Annuler Ok

Protecteur individuel de stérilité
Aucun

Emballage de protection
Aucun

Moyen de stockage
Aucun

Lieu de stockage
Couloir, salle d'attente

Durée de la stérilisation [X]

Source : afs.asso.fr
Il vous appartient de vérifier l'exactitude des informations auprès de vos fabricants des matériels utilisés pour la stérilisation

Annuler Ok

Protecteur individuel de stérilité
Aucun

- Aucun
- Papier crêpé
- Feuille non-tissé
- Sachet papier/papier
- Sachet papier/plastique
- Blistre fermeture papier
- Blistre fermeture Tyvek
- Conteneur (filtre/soupape)
- Conteneur + emballage interne non-tissé

Emballage de protection

Aucun

- Aucun
- Sac polyéthylène dos
- Bouclier de protection (conteneurs)
- Emballage de protection dos (bac, carton)

Moyen de stockage

Aucun

- Aucun
- Chariot de soins
- Armoire ou rayon ouvert
- Armoire fermée (et entretenue)

Lieu de stockage

Couloir, salle d'attente

- Couloir, salle d'attente
- Salle de soins
- Magasin de matériel
- Magasin de matériel stérile
- Zone protégé (bloc)

⇒ Durée de stérilisation fonction



⇒ Du protecteur

⇒ De l'emballage

⇒ Du stockage

⇒ Du lieu de stockage

Durée de la stérilisation ✕

 Annuler  Ok

Source : afs.asso.fr
Il vous appartient de vérifier l'exactitude des informations auprès de vos fabricants des matériels utilisés pour la stérilisation.

Protecteur individuel de stérilité
Aucun


Emballage de protection
Sac polyéthylène dos


Moyen de stockage
Armoire ou rayon ouvert

Lieu de stockage
Salle de soins

Péremption à
1 an

(à titre indicatif, selon AFNOR FDS 98-135)

Emballage : SACHET 

Péremption : 365 jours  Calculer

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Création de chaque article

⇒ **Praticien** : Dans les cabinets de groupe, possibilité de sélectionner le matériel pour tous ou par praticien

⇒ Sélection du praticien à qui le matériel stérilisé appartient

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation :

Photo :

Fabricant :

Famille :

Utilisé pour :

Emballage :

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ok Annuler Dupliquer

Praticien :

Salle : 1 2

<Tous>
Docteur Ninon CREMONINI

Ok Annuler Dupliquer

Création de chaque article

⇒ **Salle** : facultatif

⇒ Pour définir dans quelle salle l'article stérilisé sera stocké

⇒ Il n'est pas obligatoire de cocher les salles pour pouvoir noter les stérilisations dans les fiches patients

⇒ C'est juste si l'on sait où sera stocké obligatoirement l'article en fin de stérilisation

The screenshot shows a software interface for creating an instrument article. It features several input fields and a 'Salle' field highlighted with a red box. The fields include:

- Instrument
- Regroupement d'instruments
- Désignation :
- Photo :
- Fabricant :
- Famille :
- Utilisé pour :
- Emballage :
- Péréemption : jours
- Processus :
- Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Buttons at the bottom:

Création de chaque article

- ⇒ Pour confirmer la création de l'article
- ⇒ Clic sur **OK**
- ⇒ Le premier article est créé
- ⇒ L'article est enregistré dans la base des articles

The screenshot shows a form for creating an article. At the top, there are two radio buttons: 'Instrument' (selected) and 'Regroupement d'instruments'. Below are several input fields: 'Désignation', 'Photo' (with a file upload icon), 'Fabricant', 'Famille' (with a dropdown arrow and a lightbulb icon), 'Utilisé pour' (with a dropdown arrow and a lightbulb icon), 'Emballage' (with a dropdown arrow and a lightbulb icon), 'Péréemption' (with a text input, 'jours', and a 'Calculer' button), and 'Praticien' (with a dropdown arrow). At the bottom, there is a 'Salle' row with checkboxes for rooms 1 through 9. On the right side, there are three buttons: 'Ok', 'Annuler', and 'Dupliquer'. A large red arrow points to the 'Ok' button.

Création de chaque article

⇒ Et ainsi de suite pour chaque article stérilisable

Quitter Imprimer la Fiche du cycle Imprimer les étiquettes des Articles

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation
Instrument	ARRACHE COURONNE
Instrument	CISEAU
Instrument	CISEAUX A SUTURES
Instrument	CONTRE ANGLE BLEU
Instrument	CONTRE ANGLE ROUGE
Instrument	CONTRE ANGLE VERT
Instrument	CURETTE
Instrument	DAVIER BAS ENFANT
Instrument	DAVIER BAS INCISIVE
Instrument	DAVIER BAS MOLAIRE
Instrument	DAVIER BAS PREMOLAIRE
Instrument	DAVIER BAS RACINE
Instrument	DAVIER HAUT ENFANT COURBE
Instrument	DAVIER HAUT ENFANT DROIT
Instrument	DAVIER HAUT INCISIVE
Instrument	DAVIER HAUT MOLAIRE

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation :

Photo :

Fabricant :

Famille :

Utilisé pour :

Emballage :

Péremption : jours

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Traçabilité simplifiée

⇒ Lorsque les instruments unitaires stérilisables ont été renseignés, il est possible de créer des regroupements d'instruments, c'est à dire des instruments stérilisés dans le même contenant (boîte, tub, plateau, etc...)

Pour un regroupement d'articles

Tracabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clé)

Type d'article

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
05/04/2017	18:27	Cycle de stérilisation	000 000 419	
29/03/2017	18:00	Cycle de stérilisation	000 000 418	
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	000 000 417	
20/02/2017	14:20	Cycle de stérilisation	000 000 416	
06/02/2017	11:43	Cycle de stérilisation	000 000 415	
30/01/2017	14:54	Cycle de stérilisation	000 000 414	
24/01/2017	17:30	Cycle de stérilisation	000 000 413	
17/01/2017	18:37	Cycle de stérilisation	000 000 412	
09/01/2017	18:28	Cycle de stérilisation	000 000 411	
20/12/2016	15:28	Cycle de stérilisation	000 000 410	
14/12/2016	13:21	Cycle de stérilisation	000 000 409	
10/12/2016	11:39	Cycle de stérilisation	000 000 408	
09/12/2016	15:40	Cycle de stérilisation	000 000 407	
27/10/2016	16:54	Cycle de stérilisation	000 000 406	
13/10/2016	14:36	Cycle de stérilisation	000 000 405	

Créer un cycle Modifier le cycle Invalider le cycle Supprimer le cycle

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARUS 400

Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode: Vapeur - Procs 134°C 18 min.

Date: 05/04/2017 Heure: 18:27

N° de cycle: 000 000 419 Référence:

Complément: 420.pdf

Documents: 420.pdf

8 articles contenus dans le cycle

Préemption	N° d'article	Emballage	Préemption	Utilisé pour	Praticien	Date
<input type="checkbox"/>	SYNDES MOTOME CHOV 000 000 419 001	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/>	SYNDES MOTOME CHOV 000 000 419 002	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE		
<input checked="" type="checkbox"/>	SYNDES MOTOME CHOV 000 000 419 003	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE		
<input checked="" type="checkbox"/>	SYNDES MOTOME CHOV 000 000 419 004	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/>	ELEVATEUR DROIT AB 000 000 419 005	SACHET	04/07/2017	CHIRU BRICE		

Créer Modifier Supprimer

Instrument

Regroupement d'instruments!

Désignation :

Famille :

Utilisé pour :

Emballage :

Péremption : jours Calculer

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ok Annuler Dupliquer

⇒ Clic sur "créer"

⇒ On coche "regroupement d'instruments"

Pour un regroupement d'articles

Instrument **Regroupement d'instruments**

Désignation :

Famille :

Utilisé pour :

Emballage :

Péremption : jours

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Instrument **Regroupement d'instruments**

Désignation :

Famille :

Utilisé pour :

Emballage :

Péremption : jours

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

⇒ **Désignation** : nom
du regroupement

Pour un regroupement d'articles

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Imprimer la Fiche du cycle Imprimer les étiquettes des Articles

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Désignation	Désignation
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DET
Regroupement	KIT ENDO
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SOINS
Instrument	MANCHE SCALPEL
Instrument	MIROIR
Instrument	PIECE A MAIN
Instrument	PINCE COUPE OS
Instrument	PORTE AIGUILLE
Instrument	PRECELLE
Instrument	RACLEUR N°15
Instrument	RACLEUR N°20
Instrument	RACLEUR N°25
Instrument	RACLEUR N°30
Instrument	RACLEUR N°35

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation : KIT EXAMEN SIMPLE

SONDE

PRECELLE

Utilisé pour :

Emballage :

Péremption : jours

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ok Annuler Dupliquer

Traçabilité simplifiée

⇒ Double clic dans la partie supérieure, sur chaque article qui doit faire partie du regroupement

⇒ Les articles du regroupement apparaissent dans le cadre en dessous

Pour un regroupement d'articles

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Imprimer la Fiche du cycle Imprimer les étiquettes des Articles

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DET
Regroupement	KIT ENDO
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SOINS
Instrument	MANCHE SCALPEL
Instrument	MIROIR
Instrument	PIECE A MAIN
Instrument	PINCE COUPE OS
Instrument	PORTE AIGUILLE
Instrument	PRECELLE
Instrument	RACLEUR N°15
Instrument	RACLEUR N°20
Instrument	RACLEUR N°25
Instrument	RACLEUR N°30
Instrument	RACLEUR N°35

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation : KIT EXAMEN SIMPLE

SONDE
PRECELLE
MIROIR

Famille :

Utilisé pour :

Emballage :

Péremption : jours

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ok Annuler Dupliquer

Traçabilité simplifiée

⇒ Un ascenseur à droite pour voir tous les articles dans la base de données

Pour un regroupement d'articles

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Imprimer la Fiche du cycle Imprimer les étiquettes des Articles

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SOINS
Instrument	MANCHE SCALPEL
Instrument	MIROIR
Instrument	PIECE A MAIN
Instrument	PINCE COUPE OS
Instrument	PORTE AIGUILLE
Instrument	PRECELLE
Instrument	RACLEUR N°15
Instrument	RACLEUR N°20
Instrument	RACLEUR N°25
Instrument	RACLEUR N°30
Instrument	RACLEUR N°35
Instrument	RACLEUR N°40
Instrument	SEQUENCEUR ENDO
Instrument	SERINGUE ANESTHESIE

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation : KIT ENDO

RACLEUR N°20
RACLEUR N°25
RACLEUR N°30
RACLEUR N°35
RACLEUR N°40

Famille :
Utilisé pour :
Emballage :
Péremption : jours Calculer
Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ok Annuler Dupliquer

Traçabilité simplifiée

⇒ Un ascenseur à droite pour voir tous les articles dans un regroupement


Pour un regroupement d'articles

⇒ **Famille** : à remplissage optionnel

⇒ Un clic sur l'ampoule jaune à droite du champ "Famille" permet de créer les différentes familles d'instruments

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation :

Famille : 

Utilisé pour :

Emballage :

Péréemption : jours

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Familles d'instruments

CHIRURGIE

ENDODONTIE

ODF

PARO

Pour un regroupement d'articles

⇒ Utilisé pour : on retrouve par défaut, les mêmes familles créées pour les matériaux

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation :

Famille :

Utilisé pour :

Emballage :

Péremption : jours

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Familles d'utilisation des matériaux

ANESTHESIE
CHIRURGIE
DIVERS
ENDODONTIE
IMPLANTOLOGIE
ODF
PARODONTOLOGIE
PROTHESE
RADIO
SOINS CONSERVATEURS
STERILISATION-HYGIENE

Pour un regroupement d'articles

The screenshot shows a software interface for instrument management. At the top, there are two radio buttons: 'Instrument' (unselected) and 'Regroupement d'instruments' (selected). Below this is a 'Désignation' field. Further down are dropdown menus for 'Famille', 'Utilisé pour', and 'Emballage'. A red box highlights the 'Péremption' field, which contains a text input, the word 'jours', and a 'Calculer' button. Below this is a 'Salle' section with checkboxes for rooms 1 through 9. A red arrow points from the 'Calculer' button to a dialog box titled 'Durée de la stérilisation'. The dialog box has an 'Ok' button and contains the following text: 'Source : afs.asso.fr', 'Il vous appartient de vérifier l'exactitude des informations auprès de vos fabricants des matériels utilisés pour la stérilisation', and several dropdown menus: 'Protecteur individuel de stérilité' (Aucun), 'Emballage de protection' (Aucun), 'Moyen de stockage' (Aucun), and 'Lieu de stockage' (Couloir, salle d'attente).

⇒ **Péremption en jours** : selon les recommandations en vigueur 30, 60 ou 90 jours selon le type d'emballage

⇒ **Calculer** pour aide au calcul des péremptions

Pour un regroupement d'articles

⇒ **Praticien** : Dans les cabinets de groupe, possibilité de sélectionner le matériel pour tous ou par praticien

⇒ Sélection du praticien à qui le matériel stérilisé appartient

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation :

Famille :

Utilisé pour :

Emballage :

Remplacement : jours

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ok Annuler Dupliquer

Praticien :


Salle : 1 2

<Tous>
Docteur Ninon CREMONINI

Ok Annuler Dupliquer

Pour un regroupement d'articles

⇒ **Salle** : optionnel, pour définir dans quelle salle l'article stérilisé sera stocké

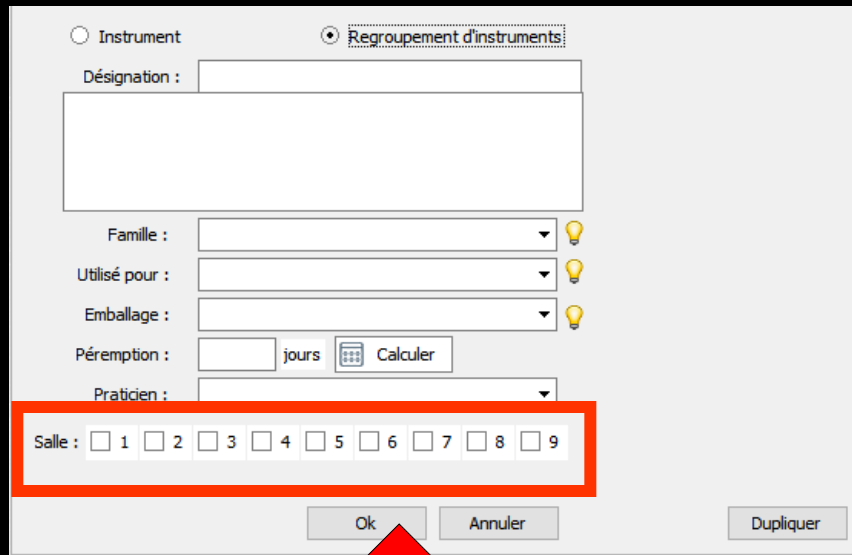

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation :

Famille :

Utilisé pour :

Emballage :

Péréemption : jours

Praticien :

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9


⇒ Quand c'est fait

⇒ **Ok**

⇒ Le regroupement est enregistré dans la base des articles

Création de chaque article

⇒ Pour dupliquer un article en lui donnant un autre nom ou en modifiant un élément d'un regroupement

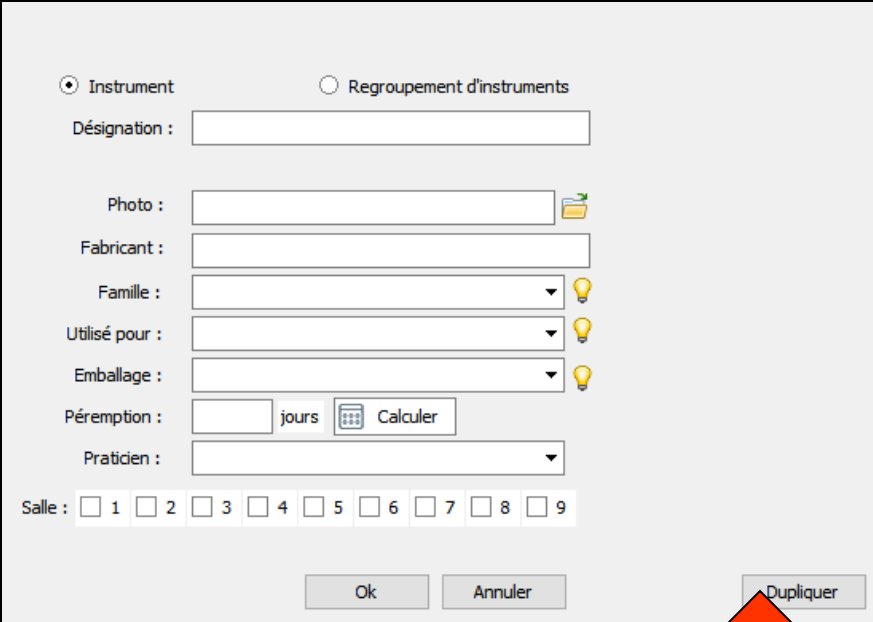

The screenshot shows a software interface for creating an article. It features two radio buttons at the top: "Instrument" (selected) and "Regroupement d'instruments". Below these are several input fields: "Désignation", "Photo" (with a folder icon), "Fabricant", "Famille" (with a dropdown arrow and a lightbulb icon), "Utilisé pour" (with a dropdown arrow and a lightbulb icon), "Emballage" (with a dropdown arrow and a lightbulb icon), "Péremption" (with a text input, "jours", a calendar icon, and a "Calculer" button), and "Praticien" (with a dropdown arrow). At the bottom, there is a "Salle" section with checkboxes for rooms 1 through 9. Three buttons are located at the bottom right: "Ok", "Annuler", and "Dupliquer". A red arrow points to the "Dupliquer" button.

Liste des articles

⇒ Un clic droit dans la table de désignation des articles permet un export sous Excel ou Word...

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI


Quitter Imprimer la Fiche du cycle Imprimer les étiquettes des Articles


Traçabilité complète

Tous les articles


Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE COURT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE GAUCHE
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DET
Regroupement	KIT ENDO
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SOINS
Instrument	MANCHE SCALPEL
Instrument	MIROIR
Instrument	PIECE A MAIN
Instrument	PINCE COUPE OS
Instrument	PORTE AIGUILLE
Instrument	PRECELLE
Instrument	RACLEUR N°15

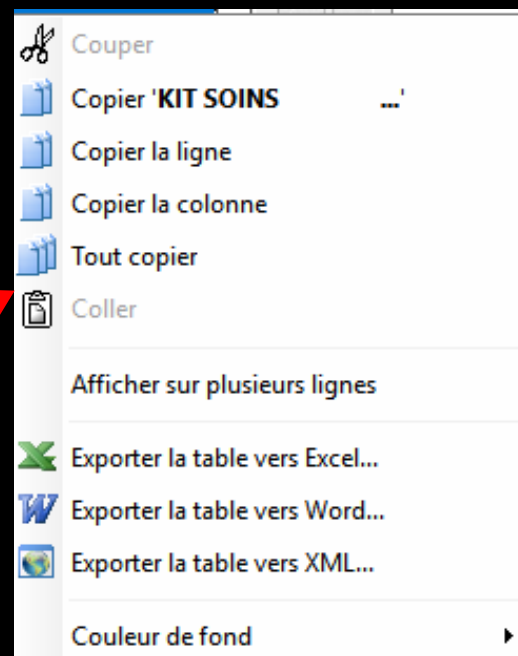

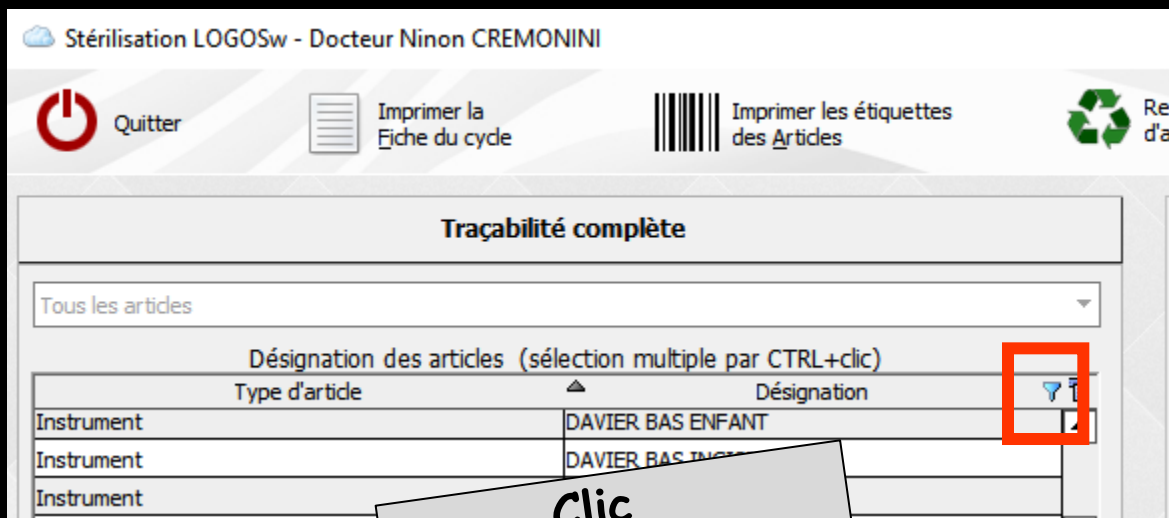

Clic
sur la petite loupe
Pour rechercher
Pour filtrer

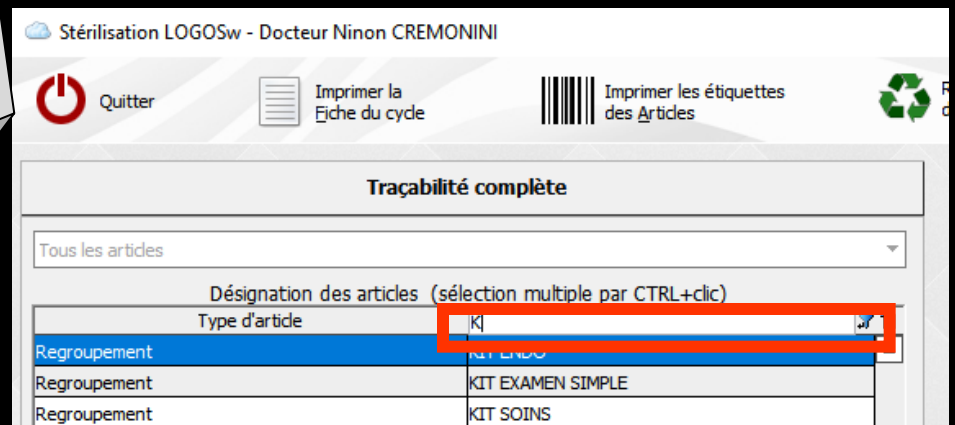

⇒ Un clic sur la petite loupe ouvre la case de recherche d'un article

⇒ Il suffit de taper les premières lettres

Clic sur la petite liste
Pour copier
Pour exporter... ..

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation
Instrument	TURBINE
Instrument	SYNDESMOTOME DROIT
Instrument	SYNDESMOTOME COURBE
Instrument	SYNDESMOTOME CHOMPRET
Instrument	SPATULE DE BOUCHE
Instrument	SPATULE A FIL DE RETRACTION
Instrument	SPATULE A CIMENT
Instrument	SONDE
Instrument	SERINGUE ANESTHESIE
Instrument	SEQUENCEUR ENDO
Instrument	RACLEUR N°40
Instrument	RACLEUR N°35
Instrument	RACLEUR N°30
Instrument	RACLEUR N°25
Instrument	RACLEUR N°20
Instrument	RACLEUR N°15






- Couper
- Copier 'TURBINE ...'
- Copier la ligne
- Copier la colonne
- Tout copier
- Coller
- Afficher sur plusieurs lignes
- Exporter la table vers Excel...
- Exporter la table vers Word...
- Exporter la table vers XML...
- Couleur de fond

Date	Heure	Cycle
13/04/2017	11:12	Cycle
05/04/2017	18:27	Cycle
29/03/2017	18:06	Cycle

Liste des articles

- ⇒ Si on veut supprimer un article
- ⇒ Sélection de l'article et clic sur "Supprimer"
- ⇒ Un message d'alerte demandera confirmation pour éviter une erreur

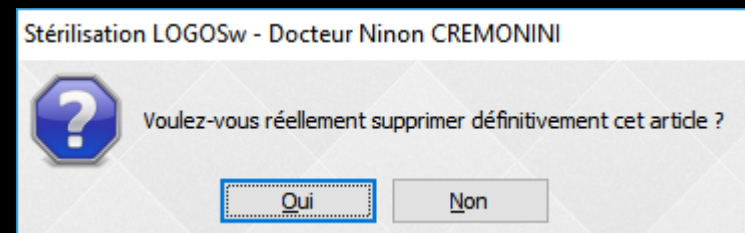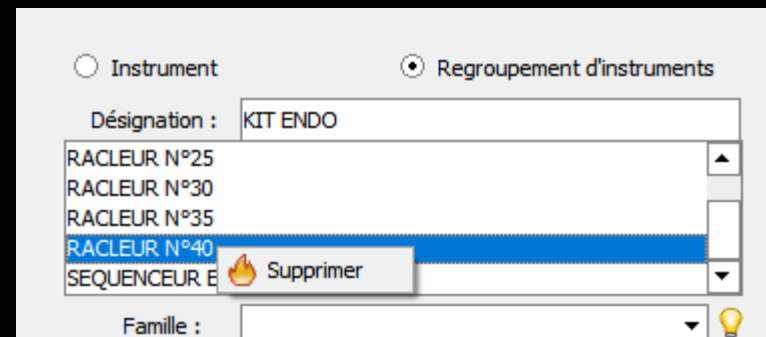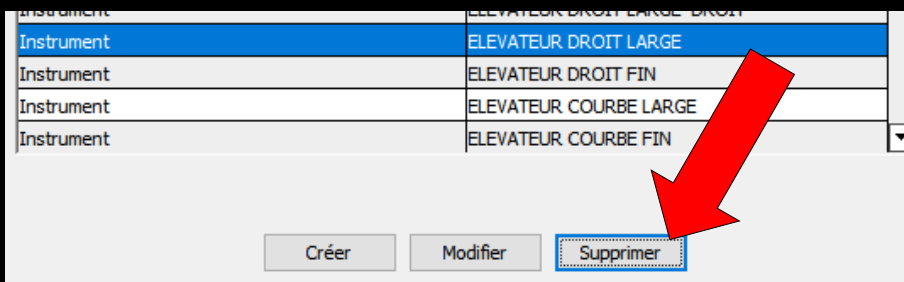

Pour un regroupement d'articles

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Imprimer la Fiche du cycle Imprimer les étiquettes des Articles

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clik)

Type d'article	Désignation
Instrument	ELEVATEUR COURBE FIN
Instrument	ELEVATEUR COURBE LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT FIN
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE COURT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE GAUCHE
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DET
Regroupement	KIT ENDO
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SOINS
Instrument	MANCHE SCALPEL
Instrument	MIROIR
Instrument	PIECE A MAIN
Instrument	PINCE COUPE OS
Instrument	PORTE AIGUILLE
Instrument	PRECELLE
Instrument	RACLEUR N°15
Instrument	RACLEUR N°20
Instrument	RACLEUR N°25
Instrument	RACLEUR N°30
Instrument	RACLEUR N°35
Instrument	RACLEUR N°40
Instrument	SEQUENCEUR ENDO
Instrument	SERINGUE ANESTHESIE
Instrument	SONDE
Instrument	SPATULE A CIMENT
Instrument	SPATULE A FIL DE RETRACTION
Instrument	SPATULE DE BOUCHE
Instrument	SYNDESMOTOME CHOMPRET
Instrument	SYNDESMOTOME COURBE
Instrument	SYNDESMOTOME DROIT
Instrument	TURBINE

Créer **Modifier** Supprimer

⇒ Si on désire supprimer un article dans un regroupement d'articles

⇒ On sélectionne le regroupement

⇒ Clic sur **modifier**

Pour un regroupement d'articles

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Imprimer la Fiche du cycle Imprimer les étiquettes des Articles

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation
Instrument	ELEVATEUR COURBE FIN
Instrument	ELEVATEUR COURBE LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT FIN
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE COURT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE GAUCHE
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DET
Regroupement	KIT ENDO
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SOINS
Instrument	MANCHE SCALPEL
Instrument	MIROIR
Instrument	PIECE A MAIN
Instrument	PINCE COUPE OS

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation : KIT ENDO

SEQUENCEUR ENDO
RACLEUR N°15
RACLEUR N°20
RACLEUR N°25
RACLEUR N°30

Famille :
Utilisé pour : ENDODONTIE
Emballage : SACHET
Péremption : 90 jours Calculer
Praticien : <Tous>

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ok Annuler Dupliquer

Traçabilité simplifiée

- ⇒ Dans le cadre inférieur
- ⇒ Sélection de l'article à enlever
- ⇒ Clic droit
- ⇒ Puis clic sur **supprimer**

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation : KIT ENDO

SEQUENCEUR ENDO
RACLEUR N°15
RACLEUR N°20
RACLEUR N°25
RACLEUR N°30

Famille :
Utilisé pour : ENDODONTIE
Emballage : SACHET
Péremption : 90 jours Calculer
Praticien : <Tous>

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ok Annuler Dupliquer

Liste des articles

⇒ Un clic sur l'entête "Type d'articles" permet un classement par type

⇒ Un clic sur l'entête "Désignation" permet un classement par ordre alphabétique ou inverse

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Imprimer la Fiche du cycle Imprimer les étiquettes des Articles

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation
Instrument	ELEVATEUR COURBE FIN
Instrument	ELEVATEUR COURBE LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT FIN
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE COURT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE GAUCHE
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DET
Regroupement	KIT ENDO
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SOINS
Instrument	MANCHE SCALPEL
Instrument	MIROIR
Instrument	PIECE A MAIN
Instrument	PINCE COUPE OS

Instrument Regroupement d'instruments

Désignation : KIT ENDO

SEQUENCEUR ENDO
RACLEUR N°15
RACLEUR N°20
RACLEUR N°25
RACLEUR N°30

Famille :

Utilisé pour : ENDODONTIE

Emballage : SACHET

Péremption : 90 jours

Praticien : <Tous>

Salle : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Traçabilité simplifiée

Liste des articles

- ⇒ Un clic sur la première colonne
- ⇒ Puis CTRL et clic sur la seconde colonne
- ⇒ Tri par ordre alphabétique des deux colonnes en même temps

The screenshot shows the 'Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI' application. At the top, there are buttons for 'Quitter', 'Imprimer la Fiche du cycle', and 'Imprimer les étiquettes des Articles'. Below this is a section titled 'Traçabilité complète' with a search bar containing 'Tous les articles'. A table lists various articles with two columns: 'Type d'article' and 'Désignation'. A red arrow points to the first column, and another red arrow points to the second column. A grey box with the text 'CTRL' is positioned to the right of the table. Below the table, there are radio buttons for 'Instrument' and 'Regroupement d'instruments'. The 'Regroupement d'instruments' option is selected, and the 'Désignation' field shows 'KIT ENDO'. Below this, there is a list of items: 'SEQUENCEUR ENDO', 'RACLEUR N°15', 'RACLEUR N°20', 'RACLEUR N°25', and 'RACLEUR N°30'. Other fields include 'Famille', 'Utilisé pour', 'Emballage', 'Péremption', and 'Praticien'. At the bottom, there are checkboxes for 'Salle' (1-9), 'Ok', 'Annuler', and 'Dupliquer' buttons.

Type d'article	Désignation
Instrument	ELEVATEUR COURBE FIN
Instrument	ELEVATEUR COURBE LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT FIN
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE COURT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE GAUCHE
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DET
Regroupement	KIT ENDO
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SOINS
Instrument	MANCHE SCALPEL
Instrument	MIROIR
Instrument	PIECE A MAIN
Instrument	PINCE COUPE OS

La traçabilité de la stérilisation

- ⇒ L'ambition n'est pas de tracer la vie d'un instrument précis, ce qui ne nous est pas demandé, mais de se rapprocher de la réalité de l'organisation de beaucoup de cabinets
- ⇒ Ainsi, pour un kit d'examen contenant miroir/sonde/précelles/spatule de bouche /canule d'aspiration, on ne cherchera pas à savoir quelle canule ou quel miroir ont été utilisés
- ⇒ Par contre, on saisira le kit d'examen d'un bloc en indiquant simplement le nombre de kits semblables contenus dans l'autoclave

Création d'un cycle de stérilisation

The screenshot displays the 'Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI' application. The interface is split into two main sections. On the left, under 'Traçabilité complète', there is a list of articles with columns for 'Type d'article' and 'Désignation'. On the right, under 'Liste des stérilisations', there is a table of past cycles and a form for creating a new one. The 'Créer un cycle' button in the form is highlighted with a red rectangle.

Date	Heure	Cycle de stérilisation	Type	N° de cycle	Référence
13/04/2017	11:12	Cycle de stérilisation		000 000 420	
05/04/2017	18:27	Cycle de stérilisation		000 000 419	
29/03/2017	19:06	Cycle de stérilisation		000 000 418	
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation		000 000 417	
20/02/2017	14:39	Cycle de stérilisation		000 000 416	
06/02/2017	11:43	Cycle de stérilisation		000 000 415	
30/01/2017	14:54	Cycle de stérilisation		000 000 414	
24/01/2017	17:36	Cycle de stérilisation		000 000 413	
17/01/2017	15:37	Cycle de stérilisation		000 000 412	
05/01/2017	18:26	Cycle de stérilisation		000 000 411	
20/12/2016	15:28	Cycle de stérilisation		000 000 410	
14/12/2016	13:21	Cycle de stérilisation		000 000 409	
17/11/2016	11:39	Cycle de stérilisation		000 000 408	
09/11/2016	15:45	Cycle de stérilisation		000 000 407	
27/10/2016	16:54	Cycle de stérilisation		000 000 406	

Créer un cycle Modifier le cycle Invalider le cycle Supprimer le cycle

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B
Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode: Vapeur - Prions 134°C 18 min.
Date: 13/04/2017 Heure: 11:12
N° de cycle: 000 000 420 Référence:
Complément: Indicateur Prions - conforme
Documents: 421.pdf

6 articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date
<input type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOM	000 000 420 001	SACHET	12/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOM	000 000 420 002	SACHET	12/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> ELEVATEUR DROIT LAR	000 000 420 003	SACHET	12/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> ELEVATEUR DROIT LAR	000 000 420 004	SACHET	12/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> DAVIER BAS MOLAIRE	000 000 420 005	SACHET	12/07/2017	CHIRURGIE		

- ⇒ Dans la partie droite de la fenêtre de stérilisation
- ⇒ Clic sur "Créer un cycle"

Création d'un cycle de stérilisation

Certains champs sont remplis par défaut et gardés en mémoire pour un prochain cycle de stérilisation

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Imprimer la Fiche du cycle Imprimer les étiquettes des Articles Re-stérilisation d'articles périmés Import de fichiers Recherches Historique Aide

Traçabilité complète

Tous les articles

	N° de cycle	Référence
	000 000 420	
	000 000 419	
	000 000 418	
	000 000 417	
	000 000 416	
	000 000 415	
	000 000 414	
	000 000 413	
	000 000 412	
	000 000 411	
	000 000 410	
	000 000 409	
	000 000 408	
	000 000 407	
	000 000 406	
	000 000 405	

Date	Heure	Description
20/12/2016	15:28	Cycle de stérilisation
14/12/2016	13:21	Cycle de stérilisation
17/11/2016	11:39	Cycle de stérilisation
09/11/2016	15:45	Cycle de stérilisation
27/10/2016	16:54	Cycle de stérilisation
13/10/2016	14:25	Cycle de stérilisation

Instrument	Description
	INSTRUMENTS DET
Instrument	RACLEUR N°35
Instrument	RACLEUR N°30
Instrument	RACLEUR N°25
Instrument	MANCHE SCALPEL
Instrument	SYNDESMOTOME COURBE
Instrument	MIROIR
Instrument	PIECE A MAIN
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE GAUCHE
Instrument	PINCE COUPE OS
Instrument	SYNDESMOTOME DROIT
Instrument	SYNDESMOTOME CHOMPRET
Instrument	DAVIER BAS PREMOLAIRE
Instrument	SPATULE DE BOUCHE
Instrument	PORTE AIGUILLE
Instrument	DAVIER BAS ENFANT
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	ARRACHE COURONNE
Instrument	RACLEUR N°40
Instrument	SEQUENCEUR ENDO
Instrument	SERINGUE ANESTHESIE
Instrument	SONDE
Instrument	SPATULE A CIMENT
Instrument	SPATULE A FIL DE RETRACTION
Instrument	DAVIER BAS RACINE

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 408

Type de cycle : Cycle de stérilisation Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date : 25/04/2017 Heure : 18:04

N° de cycle : 000 000 421 Référence :

Complément :

Documents :

Articles contenus dans le cycle

Désignation	Número	Emballage	Péréption	Utilisé pour	Praticien	Date

Nombre d'articles identiques à ajouter au cycle : 1

Créer Modifier Supprimer

Traçabilité simplifiée

Sauver le cycle Annuler

Création d'un cycle de stérilisation

Opérateur : NC

Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle: Cycle de stérilisation

Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date: 25/04/2017

Heure : 18:04

N° de cycle : 000 000 421

Référence :

Complément :

Documents :

Articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date

Sauver le cycle Annuler

⇒ **Opérateur** : les initiales de l'opérateur, remplissage automatique, mais modifiable

Création d'un cycle de stérilisation

Opérateur : NC

Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode: Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date: 25/04/2017 Heure: 18:04

N° de cycle: 000 000 421 Référence:

Complément:

Documents:

Articles contenus dans le cycle						
Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date

Sauver le cycle Annuler

Stérilisateurs

Annuler Ok Ajouter Détruire

UNIDENT AQUARIUS 40B

- ⇒ **Stérilisateur** : le nom de l'autoclave utilisé, remplissage automatique, après la première fois, mais modifiable
- ⇒ L'ampoule jaune en bout de champ permet d'ajouter, de détruire

Création d'un cycle de stérilisation

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle : Cycle de stérilisation Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date : 25/04/2017 Heure : 18:04

N° de cycle : 000 000 421 Référence :

Complément :

Documents :

Articles contenus dans le cycle						
Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date

Sauver le cycle Annuler

⇒ **Type de cycle :**
par défaut cycle
de stérilisation

⇒ **Les cycles de test**
(Bowie&Dick, test Helix
etc...) pourront être
tracés au sein même du
module de stérilisation
(avec possibilité de
stocker les photos ou
scans des résultats)

Opérateur : NC Stérilisateur :

Type de cycle : Cycle de stérilisation Mode :

Date : Cycle de test

Création d'un cycle de stérilisation

⇒ **Mode** : à remplir par le combo box

Opérateur : NC

Type de cycle: Cycle de stérilisation

Date: 25/04/2017

N° de cycle: 000 000 421

Référence :

Complément :

Documents :

Articles contenus dans le cycle						
Désignation	Numéro	Emballage	Péréemption	Utilisé pour	Praticien	Date

Sauver le cycle

Annuler

Modes de stérilisation

Annuler Ok Ajouter Détruire

Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Vapeur - Plastique 121°C 20 min.

Oxyde d'éthylène

Sterrad

⇒ **L'ampoule jaune** en bout de champ permet d'ajouter ou de détruire des modes de stérilisation

Mode :

Heure:

Référence :

Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Vapeur - Plastique 121°C 20 min.

Oxyde d'éthylène

Sterrad

Création d'un cycle de stérilisation

Opérateur : NC Stérilisateur : L'INIDENT AGLIARTUS 40B

Type de cycle: Cycle de stérilisation **Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.**

Date: 25/04/2017 Heure : 18:04

N° de cycle : 000 000 421 Référence :

Complément :

Documents :


Articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date

Sauver le cycle Annuler

⇒ **Mode** : remplissage obligatoire

⇒ Si oubli, un message de rappel

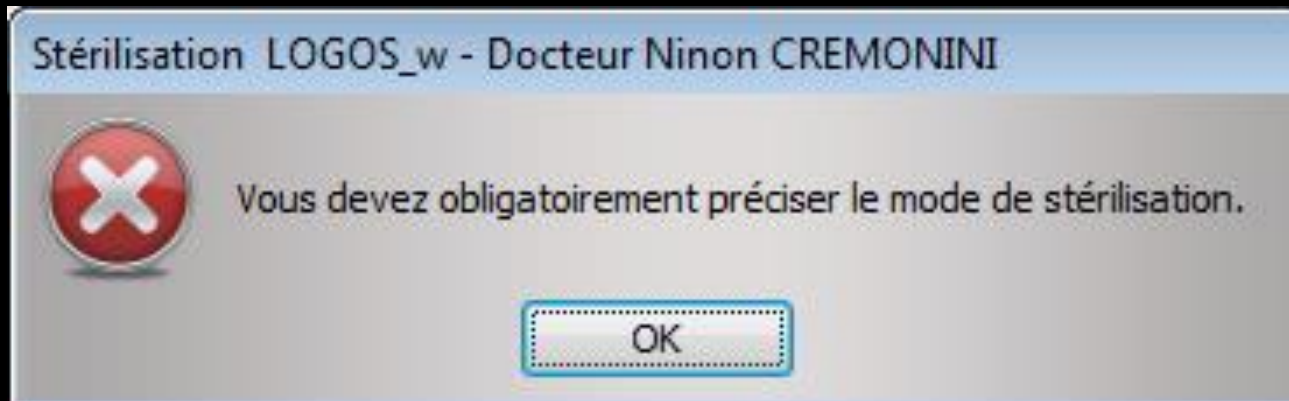

Création d'un cycle de stérilisation

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date : 25/04/2017

Heure : 18:04

N° de cycle : 000 000 421 Référence :

Complément :

Documents :

Articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date

Sauver le cycle

Choix d'une date

04 2017

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Marc

Aujourd'hui

Ok Annuler

⇒ **Date** : par défaut la date du jour mais modifiable

⇒ À droite un calendrier

Création d'un cycle de stérilisation

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date: 25/04/2017 **Heure : 18:04**

N° de cycle : 000 000 421 Référence :

Complément :

Documents :

Articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date

Sauver le cycle Annuler

⇒ **Heure** : par défaut heure de la saisie, mais modifiable

Création d'un cycle de stérilisation

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date: 25/04/2017 Heure : 18:04

N° de cycle : 000 000 421 Référence :

Complément :

Documents :

Articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péréemption	Utilisé pour	Praticien	Date

Sauver le cycle Annuler

⇒ **Numéro de cycle** : donné par le logiciel, non modifiable à incrémentation automatique

Création d'un cycle de stérilisation

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date: 25/04/2017 Heure : 18:04

N° de cycle : 000 000 421 **Référence :**

Complément :

Documents :

Articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date

Sauver le cycle Annuler

⇒ **Référence :**

⇒ À remplir mais optionnel

⇒ Numéro du cycle interne à l'autoclave (ou tout autre repère de son choix)

Création d'un cycle de stérilisation

Apparition des articles dans le cycle de stérilisation en cours de création

3 articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Périemption	Utilisé pour	Pratice	Date
<input type="checkbox"/> KIT ENDO	000 000 422 001	SACHET	25/07/2017	ENDODONTIE		
<input type="checkbox"/> KIT EXAMEN SIMPLE	000 000 422 002	SACHET	25/07/2017	STERILISATI		
<input type="checkbox"/> KIT SOINS	000 000 422 003	SACHET	25/07/2017	SOINS CONE		

⇒ Le stock d'instruments étant établi, on n'aura plus qu'à **double-cliquer** dans la partie gauche de la fenêtre sur les regroupements ou les instruments de son choix pour les intégrer au cycle de stérilisation

Création d'un cycle de stérilisation

Tracabilité complète

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
25/04/2017	16:48	Cycle de stérilisation	800 000 421	
13/04/2017	11:12	Cycle de stérilisation	800 000 420	
15/04/2017	18:27	Cycle de stérilisation	800 000 419	
29/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	800 000 418	
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	800 000 417	
20/02/2017	14:39	Cycle de stérilisation	800 000 416	
06/02/2017	11:43	Cycle de stérilisation	800 000 415	
30/01/2017	14:54	Cycle de stérilisation	800 000 414	
24/01/2017	17:36	Cycle de stérilisation	800 000 413	
17/01/2017	15:37	Cycle de stérilisation	800 000 412	
05/01/2017	18:35	Cycle de stérilisation	800 000 411	
20/12/2016	15:28	Cycle de stérilisation	800 000 410	
14/12/2016	13:21	Cycle de stérilisation	800 000 409	
17/11/2016	11:39	Cycle de stérilisation	800 000 408	
09/11/2016	15:45	Cycle de stérilisation	800 000 407	

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 408

Date : 26/04/2017 Heure : 16:46

Cycle de stérilisation : Mode : Vapeur - Phospho L54°C 18 min.

Complément : Référence : Documents :

Désignation	Numero	Emballage	Preparation	Utilisé pour	Pratiqué	Date
KIT ENDO	800 000 422 001	SACHET	25/07/2017	ENDODONTIE		
KIT EXAMEN SIMPLE	800 000 422 002	SACHET	25/07/2017	STERILISATION HPGE		
KIT SCORES	800 000 422 003	SACHET	25/07/2017	SCORES CONSERVATELS		

Créer Modifier Supprimer

Tracabilité simplifiée

Sauver le cycle Annuler

Tracabilité complète

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
25/04/2017	16:48	Cycle de stérilisation	800 000 421	
13/04/2017	11:12	Cycle de stérilisation	800 000 420	
15/04/2017	18:27	Cycle de stérilisation	800 000 419	
29/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	800 000 418	
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	800 000 417	
20/02/2017	14:39	Cycle de stérilisation	800 000 416	
06/02/2017	11:43	Cycle de stérilisation	800 000 415	
30/01/2017	14:54	Cycle de stérilisation	800 000 414	

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 408

Date : 26/04/2017 Heure : 16:46

Cycle de stérilisation : Mode : Vapeur - Phospho L54°C 18 min.

Complément : Référence : Documents :

Désignation	Numero	Emballage	Preparation	Utilisé pour	Pratiqué	Date
KIT ENDO	800 000 422 001	SACHET	25/07/2017	ENDODONTIE		
KIT EXAMEN SIMPLE	800 000 422 002	SACHET	25/07/2017	STERILISATION HPGE		
KIT SCORES	800 000 422 003	SACHET	25/07/2017	SCORES CONSERVATELS		

Créer Modifier Supprimer

Tracabilité simplifiée

Sauver le cycle Annuler

Apparition des articles dans le cycle de stérilisation en cours de création

⇒ **Autre possibilité** : sélection dans la partie gauche de la fenêtre du regroupement ou de l'instrument de son choix puis clic sur la flèche verte pointant vers la droite

⇒ La flèche verte pointant vers la gauche permettant après sélection d'enlever un article mis dans le cycle par erreur

Création d'un cycle de stérilisation

En résumé

⇒ Pour entrer les différents articles dans le cycle de stérilisation

⇒ **Sélection** de l'article dans la partie gauche de la fenêtre et clic sur la flèche **verte** pointée vers la droite

⇒ Ou **double clic** sur l'article

The screenshot displays the Sterilization LOGOsw software interface. On the left, a list of articles is shown under 'Tous les articles'. The list includes various instruments such as 'MARCHA COURONNE', 'EISEAU', 'CISEAU A SUTURES', 'CONTRE ANGLE BLEU', 'CONTRE ANGLE ROUGE', 'CONTRE ANGLE VERT', 'CURETTE', 'DAVERER BAS ENFANT', 'DAVERER BAS INCISIVE', 'DAVERER BAS MOLARINE', 'DAVERER BAS PERMO-LAINE', 'DAVERER BAS RACINE', 'DAVERER HAUT ENFANT COURBE', 'DAVERER HAUT ENFANT DROIT', 'DAVERER HAUT INCISIVE', 'DAVERER HAUT MOLARINE', 'DAVERER HAUT PERMO-LAINE', 'DAVERER HAUT RACINE', 'ELEVATEUR COURBE', 'ELEVATEUR COURBE FIN', 'ELEVATEUR COURBE LARGE', 'ELEVATEUR DROIT FIN', 'ELEVATEUR DROIT LARGE', 'ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT', 'ELEVATEUR DROIT LARGE COUBT', 'ELEVATEUR DROIT LARGE GAUCHE', 'ENCLAVATEUR', 'INERT EMS DET', 'KIT ENDO', 'KIT EXAMEN SIMPLE', 'MANCHE SCALPEL', 'MBOUR', and 'FORCE A MAIN'. The 'KIT EXAMEN SIMPLE' article is selected. On the right, the 'Liste des stérilisations' table shows a list of cycles with columns for Date, Heure, Type, N° de cycle, and Référence. Below the table, the cycle configuration screen is visible, showing 'Opérateur : HC', 'Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 408', 'Type de cycle : Cycle de stérilisation', 'Mode : Vapeur - Pions 134°C 18 min.', 'Date : 20/04/2017', 'Heure : 16:46', 'N° de cycle : 000 000 422', and 'Référence :'. A section titled '3 articles contenus dans le cycle' lists the selected articles: 'KIT ENDO', 'KIT EXAMEN SIMPLE', and 'KIT SOINS'. At the bottom, there are buttons for 'Sauver le cycle' (Save cycle) and 'Annuler' (Cancel).

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
25/04/2017	16:48	Cycle de stérilisation	000 000 421	
13/04/2017	11:12	Cycle de stérilisation	000 000 420	
05/04/2017	10:27	Cycle de stérilisation	000 000 419	
29/03/2017	10:56	Cycle de stérilisation	000 000 418	
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	000 000 417	
20/02/2017	14:39	Cycle de stérilisation	000 000 416	
06/02/2017	11:43	Cycle de stérilisation	000 000 415	
30/01/2017	14:54	Cycle de stérilisation	000 000 414	
24/01/2017	17:36	Cycle de stérilisation	000 000 413	
17/01/2017	15:52	Cycle de stérilisation	000 000 412	
05/01/2017	10:28	Cycle de stérilisation	000 000 411	
20/12/2016	15:20	Cycle de stérilisation	000 000 410	
14/12/2016	13:21	Cycle de stérilisation	000 000 409	
17/11/2016	11:59	Cycle de stérilisation	000 000 408	
09/11/2016	15:45	Cycle de stérilisation	000 000 407	

Sélection

Instrument	ELEVATEUR COURBE
Instrument	ELEVATEUR COURBE FIN
Instrument	ELEVATEUR COURBE LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT FIN
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE COURT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE GAUCHE
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DET
Regroupement	INSTRUMENT ENDO
Regroupement	INSTRUMENT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	INSTRUMENT SOINS
Instrument	INSTRUMENT ANCHE SCALPEL
Instrument	INSTRUMENT ROIR
Instrument	INSTRUMENT CE A MAIN

Nombre d'articles identiques à ajouter au cycle:

Nombre

Créer Modifier Supprimer

Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode: Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date: 26/04/2017 Heure: 16:46

N° de cycle: 000 000 422 Référence:

Complément:

Documents:

13 articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péréemption	Utilisé pour	Praticien	Date c
<input type="checkbox"/> KIT SOINS	000 000 422 009	SACHET	25/07/2017	SOINS CONSERVATEL		
<input type="checkbox"/> KIT SOINS	000 000 422 010	SACHET	25/07/2017	SOINS CONSERVATEL		
<input type="checkbox"/> KIT SOINS	000 000 422 011	SACHET	25/07/2017	SOINS CONSERVATEL		
<input type="checkbox"/> KIT SOINS	000 000 422 012	SACHET	25/07/2017	SOINS CONSERVATEL		
<input type="checkbox"/> KIT SOINS	000 000 422 013	SACHET	25/07/2017	SOINS CONSERVATEL		

Les articles sont mis dans le cycle

- ⇒ Pour un article en plusieurs exemplaires à mettre dans le cycle de stérilisation
 - ⇒ Sélection de l'article
 - ⇒ Mettre le nombre d'articles identiques
 - ⇒ Clic sur la flèche verte dirigée vers la droite

Création d'un cycle de stérilisation

- ➔ Quand tous les articles à stériliser sont mis dans le cycle de stérilisation
- ➔ Clic sur "Sauver le cycle"
- ➔ Ou "Annuler" si on a fait une erreur

The screenshot displays the 'Stérilisation LOGOSv - Docteur Ninon CREMONINI' software interface. The left pane shows a list of articles under 'Tracabilité complète'. The right pane shows the 'Liste des stérilisations' table and the cycle configuration form.

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
25/04/2017	16:48	Cycle de stérilisation	000 000 421	
13/04/2017	11:12	Cycle de stérilisation	000 000 420	
05/04/2017	18:27	Cycle de stérilisation	000 000 419	
29/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	000 000 418	
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	000 000 417	
20/02/2017	14:39	Cycle de stérilisation	000 000 416	
06/02/2017	11:43	Cycle de stérilisation	000 000 415	
30/01/2017	14:54	Cycle de stérilisation	000 000 414	
24/01/2017	17:36	Cycle de stérilisation	000 000 413	
17/01/2017	15:37	Cycle de stérilisation	000 000 412	
05/01/2017	18:26	Cycle de stérilisation	000 000 411	
20/12/2016	15:28	Cycle de stérilisation	000 000 410	
14/12/2016	13:21	Cycle de stérilisation	000 000 409	
17/11/2016	11:39	Cycle de stérilisation	000 000 408	
09/11/2016	15:45	Cycle de stérilisation	000 000 407	
			000 000 406	

Configuration form details:

- Opérateur : NC
- Stérilisateur : UNIDENT AQUAREJUS 408
- Type de cycle : Cycle de stérilisation
- Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.
- Date : 26/04/2017
- Heure : 16:46
- N° de cycle : 000 000 422
- Référence :
- Complément :
- Documents :

Articles contents in the cycle:

Désignation	Numéro	Emballage	Périemprunt	Utilisé pour	Pratiquen	Date
[X] KIT SOINS	000 000 422 009	SACHET	25/07/2017	SOINS CONSERVATEL		
[X] KIT SOINS	000 000 422 010	SACHET	25/07/2017	SOINS CONSERVATEL		
[X] KIT SOINS	000 000 422 011	SACHET	25/07/2017	SOINS CONSERVATEL		
[X] KIT SOINS	000 000 422 012	SACHET	25/07/2017	SOINS CONSERVATEL		
[X] KIT SOINS	000 000 422 013	SACHET	25/07/2017	SOINS CONSERVATEL		

Buttons at the bottom: **Sauver le cycle** (blue checkmark) and **Annuler** (red X).

Cycle de stérilisation

- ⇒ Quand le cycle de stérilisation est terminé
- ⇒ On vérifie les testeurs placés dans l'autoclave
- ⇒ On sélectionne dans le module de stérilisation le cycle qui vient d'être terminé
- ⇒ Clic sur **modifier le cycle**

The screenshot shows the 'Sterilization LOGOS' software interface. At the top, there's a menu bar with 'Quitter', 'Ajouter les étiquettes des articles', 'Re distribution', 'Import de données', 'Recherches', and 'Aide'. Below the menu, there's a 'Traçabilité complète' section with a list of articles. A red box highlights the 'Modifier le cycle' button in the 'Liste des stérilisations' table. The table has columns for 'Date', 'Heure', 'N° de cycle', and 'Référence'. A red arrow points from the 'Modifier le cycle' button to the 'Modifier le cycle' button in the bottom right corner of the interface.



⇒ Si le test est bon

The screenshot shows the 'Complément' and 'Documents' fields. The 'Complément' field has a dropdown menu with 'Indicateur Prions - conforme' selected. The 'Documents' field has a text input with 'Indicateur Prions - non conforme'.



The screenshot shows the 'Complément' field with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing 'Indicateur Prions - conforme' as the selected option.

Cycle de stérilisation

- ⇒ **Complément** : indicateur test prions, conforme ou non-conforme
- ⇒ L'ampoule à droite du champ ouvrant la fenêtre des compléments

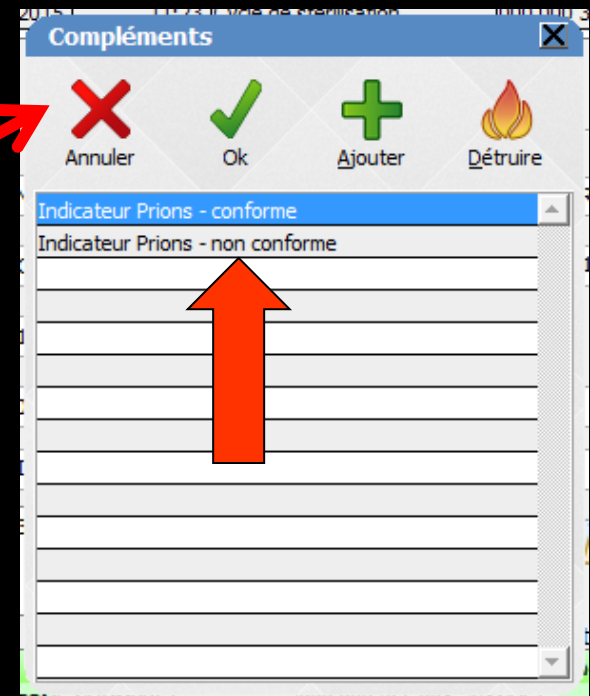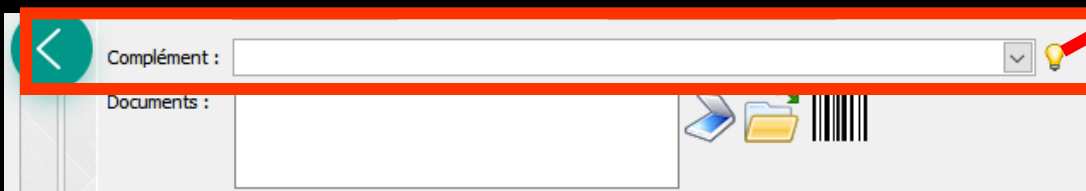

Cycle de stérilisation

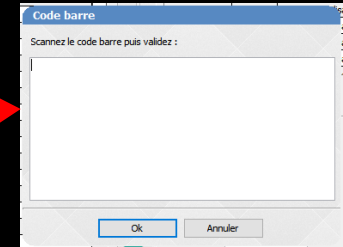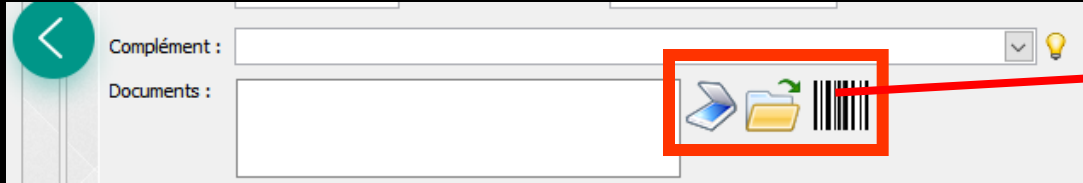


⇒ Documents

⇒ On scanne le ticket de stérilisation (scan intégré), le test-prions

⇒ On enregistre le fichier informatique de la carte-mémoire ou tout autre fichier informatique

⇒ Un double clic sur l'image scannée et visualisation

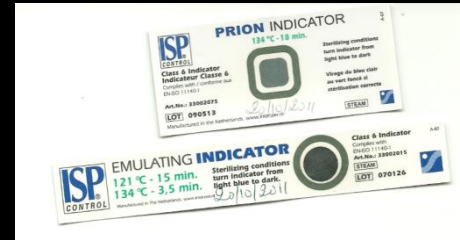


Les documents pouvant être associés au cycle de stérilisation

- Documents à scanner
- Documents pris dans un répertoire (icône petit fichier)
- Scan d'un code barre

Cycle de stérilisation

⇒ Quand tous les documents que l'on veut associer sont rentrés et que tout est fait

⇒ Clic sur **sauver le cycle**

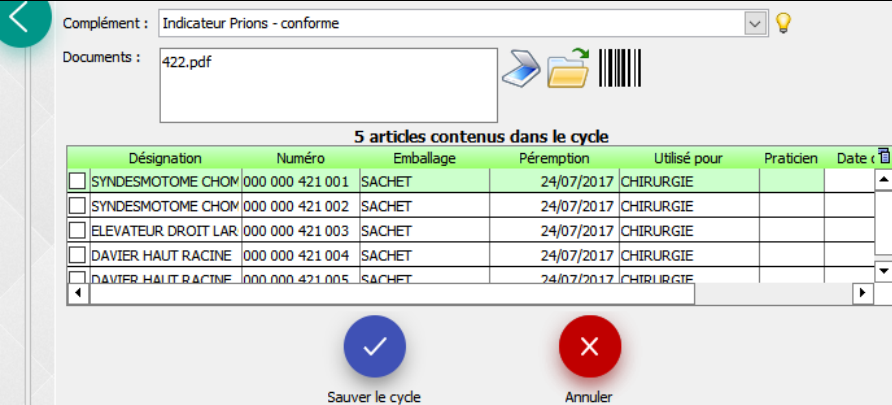

Complément : Indicateur Prions - conforme

Documents : 422.pdf

5 articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date r
<input type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOM	000 000 421 001	SACHET	24/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOM	000 000 421 002	SACHET	24/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> ELEVATEUR DROIT LAR	000 000 421 003	SACHET	24/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> DAVIER HAUT RACINE	000 000 421 004	SACHET	24/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> DAVIER HAUT RACINE	000 000 421 005	SACHET	24/07/2017	CHIRURGIE		

Sauver le cycle Annuler

Le cycle de stérilisation est enregistré

On effectue les modifications et on valide en cliquant sur "Sauver le cycle"

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Imprimer la Fiche du cycle Imprimer les étiquettes des articles Re-stérilisation d'articles périmés Import de fichiers Recherches Historique Aide

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation
Instrument	ARRACHE COURONNE
Instrument	CESEAU
Instrument	CESEAUX A SUTURES
Instrument	CONTRE ANGLE BLEU
Instrument	CONTRE ANGLE ROUGE
Instrument	CONTRE ANGLE VERT
Instrument	CURETTE
Instrument	DAVIER BAS ENFANT
Instrument	DAVIER BAS INCISIVE
Instrument	DAVIER BAS MOLLAIRE
Instrument	DAVIER BAS PREMOLAIRE
Instrument	DAVIER BAS RACINE
Instrument	DAVIER HAUT ENFANT COURBE
Instrument	DAVIER HAUT ENFANT DROIT
Instrument	DAVIER HAUT INCISIVE
Instrument	DAVIER HAUT MOLLAIRE
Instrument	DAVIER HAUT PREMOLAIRE
Instrument	DAVIER HAUT RACINE
Instrument	ELEVATEUR COURBE
Instrument	ELEVATEUR COURBE FIN
Instrument	ELEVATEUR COURBE LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT FIN
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE COURT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE GAUCHE
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DIET
Regroupement	KIT ENDO
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SCOPES
Instrument	MANCHE SCALPEL
Instrument	MERCIR
Instrument	PIECE A MAIN

Nombre d'articles identiques à ajouter au cycle: 30

Créer Modifier Supprimer

Liste des stérilisations

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
25/04/2017	16:48	Cycle de stérilisation	000 000 421	
13/04/2017	11:12	Cycle de stérilisation	000 000 420	
05/04/2017	18:27	Cycle de stérilisation	000 000 419	
29/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	000 000 418	
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	000 000 417	
20/02/2017	14:39	Cycle de stérilisation	000 000 416	
06/02/2017	11:43	Cycle de stérilisation	000 000 415	
30/01/2017	14:54	Cycle de stérilisation	000 000 414	
24/01/2017	17:36	Cycle de stérilisation	000 000 413	
17/01/2017	15:37	Cycle de stérilisation	000 000 412	
05/01/2017	18:26	Cycle de stérilisation	000 000 411	
20/12/2016	15:28	Cycle de stérilisation	000 000 410	
14/12/2016	13:21	Cycle de stérilisation	000 000 409	
17/11/2016	11:39	Cycle de stérilisation	000 000 408	
09/11/2016	15:45	Cycle de stérilisation	000 000 407	

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 408

Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode: Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date: 25/04/2017 Heure: 16:48

N° de cycle: 000 000 421 Référence:

Complément: Indicateur Prions - conforme

Documents: 422.pdf

Articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	ballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date
<input type="checkbox"/> SYNDERMOTOME CHOM	000 000 421 001		24/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> SYNDERMOTOME CHOM	000 000 421 002		24/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> ELEVATEUR DROIT LAR	000 000 421 003		24/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> DAVIER HAUT RACINE	000 000 421 004		24/07/2017	CHIRURGIE		
<input type="checkbox"/> DAVIER HAUT RACINE	000 000 421 005		24/07/2017	CHIRURGIE		

Sauver le cycle Annuler

Si un cycle s'est mal effectué

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Imprimer les étiquettes des articles Re-stérilisation d'articles périmés Import de fichiers Recherches Historique Aide

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation
Instrument	ARRACHE COURONNE
Instrument	CISEAU
Instrument	CISEAUX A SUTURES
Instrument	CONTRE ANGLE BLEU
Instrument	CONTRE ANGLE ROUGE
Instrument	CONTRE ANGLE VERT
Instrument	CURETTE
Instrument	DAVIER BAS ENFANT
Instrument	DAVIER BAS INCISIVE
Instrument	DAVIER BAS MOULAIRE
Instrument	DAVIER BAS PREMOLAIRE
Instrument	DAVIER BAS RACINE
Instrument	DAVIER HAUT ENFANT COURSE
Instrument	DAVIER HAUT ENFANT DROIT
Instrument	DAVIER HAUT INCISIVE
Instrument	DAVIER HAUT MOULAIRE
Instrument	DAVIER HAUT PREMOLAIRE
Instrument	DAVIER HAUT RACINE
Instrument	ELEVATEUR COURBE
Instrument	ELEVATEUR COL
Instrument	ELEVATEUR COL
Instrument	ELEVATEUR DROIT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE COURT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LAR
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DET
Regroupement	KIT ENDO
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SOINS
Instrument	MANCHE SCALPEL
Instrument	MIROIR
Instrument	PIECE A MAIN

Liste des stérilisations

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
25/04/2017	16:48	Cycle de stérilisation	000 000 421	
13/04/2017	11:12	Cycle de stérilisation	000 000 420	
05/04/2017	18:27	Cycle de stérilisation	000 000 419	
25/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	000 000 418	
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	000 000 417	
20/02/2017	14:39	Cycle de stérilisation	000 000 416	
06/02/2017	11:43	Cycle de stérilisation	000 000 415	
30/01/2017	14:54	Cycle de stérilisation	000 000 414	
24/01/2017	17:36	Cycle de stérilisation	000 000 413	
17/01/2017	15:37	Cycle de stérilisation	000 000 412	
05/01/2017	18:26	Cycle de stérilisation	000 000 411	
20/12/2016	15:28	Cycle de stérilisation	000 000 410	
14/12/2016	13:21	Cycle de stérilisation	000 000 409	
17/11/2016	11:39	Cycle de stérilisation	000 000 408	
09/11/2016	15:45	Cycle de stérilisation	000 000 407	

Modifier le cycle Invalider le cycle Imprimer le cycle

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUIARIUS 408

Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode: Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Complément : Indicateur Prions - conforme

Avec message de confirmation

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Êtes-vous absolument certain de vouloir invalider ce cycle ?

Qui Non

Date	Utilisé pour	Praticien	Date
07/2017	CHIRURGIE		
07/2017	CHIRURGIE		
07/2017	CHIRURGIE		
07/2017	CHIRURGIE		
07/2017	CHIRURGIE		
07/2017	CHIRURGIE		

Créer Modifier Supprimer

Traçabilité simplifiée

Le numéro de cycle est conservé
Le cycle est noté "invalidé"

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Imprimer la Fiche du cycle Imprimer les étiquettes des Articles Re-stérilisation d'articles périmés Import de fichiers Recherches Historique Aide

Traçabilité complète

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clik)

Type d'article	Désignation
Instrument	ARRACHE COURONNE
Instrument	CISEAU
Instrument	CISEAUX A SUTURES
Instrument	CONTRE ANGLE BLEU
Instrument	CONTRE ANGLE ROUGE
Instrument	
Instrument	
Instrument	DAVIER HAUT PREMOLAIRE
Instrument	DAVIER HAUT RACINE
Instrument	ELEVATEUR COURBE
Instrument	ELEVATEUR COURBE FIN
Instrument	ELEVATEUR COURBE LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT FIN
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE COURT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE GAUCHE
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DET
Regroupement	KIT ENDO
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SOINS
Instrument	MANCHE SCALPEL
Instrument	MIROIR
Instrument	PIECE A MAIN

Créer Modifier Supprimer

Traçabilité simplifiée

Liste des stérilisations

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
25/04/2017	16:48	Cycle de stérilisation	000 000 421	
13/04/2017	11:12	Cycle de stérilisation	000 000 420	
05/04/2017	18:27	Cycle de stérilisation	000 000 419	
29/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	000 000 418	
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	000 000 417	
20/02/2017	14:39	Cycle de stérilisation	000 000 416	
06/02/2017	11:43	Cycle de stérilisation	000 000 415	
30/01/2017	14:54	Cycle de stérilisation	000 000 414	
24/01/2017	17:36	Cycle de stérilisation	000 000 413	
17/01/2017	15:37	Cycle de stérilisation	000 000 412	
05/01/2017	18:26	Cycle de stérilisation	000 000 411	
20/12/2016	15:28	Cycle de stérilisation	000 000 410	
14/12/2016	13:21	Cycle de stérilisation	000 000 409	
17/11/2016	11:39	Cycle de stérilisation	000 000 408	
09/11/2016	15:45	Cycle de stérilisation	000 000 407	
23/10/2016	16:54	Cycle de stérilisation	000 000 406	

Créer un cycle Modifier le cycle **Invalider le cycle** Supprimer le cycle

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle : Cycle de stérilisation Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date : 25/04/2017 Heure : 16:48

N° de cycle : 000 000 421 Référence :


Complément : **Cycle invalidé**

Documents : 422.pdf

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date
<input checked="" type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOM	000 000 421 001	SACHET	24/07/2017	CHIRURGIE		
<input checked="" type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOM	000 000 421 002	SACHET	24/07/2017	CHIRURGIE		
<input checked="" type="checkbox"/> ELEVATEUR DROIT LAR	000 000 421 003	SACHET	24/07/2017	CHIRURGIE		
<input checked="" type="checkbox"/> DAVIER HAUT RACINE	000 000 421 004	SACHET	24/07/2017	CHIRURGIE		
<input checked="" type="checkbox"/> DAVIER HAUT RACINE	000 000 421 005	SACHET	24/07/2017	CHIRURGIE		

Tous les articles du cycle sont cochés comme à re-stériliser

- ⇒ Un cycle de stérilisation ne pourra être supprimé par erreur
- ⇒ Message d'alerte empêchant de supprimer un cycle dont au moins un article a été utilisé

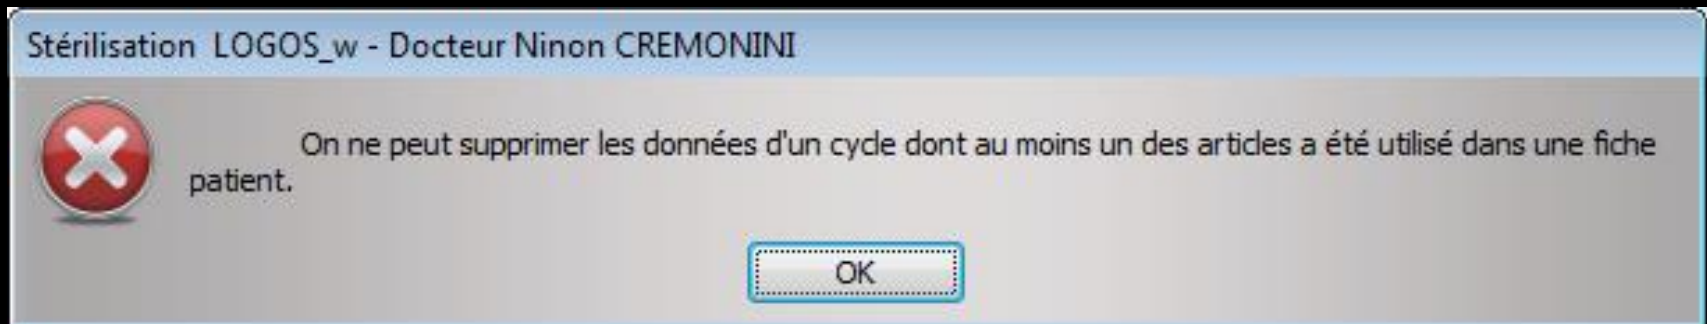





Modification d'un cycle de stérilisation

6 articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date d'utilisation	Patient
<input type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 355 001	SACHET	10/01/2016	CHIRURGIE			
<input type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 355 002	SACHET	10/01/2016	CHIRURGIE			
<input type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 355 003	SACHET	10/01/2016	CHIRURGIE			
<input type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 355 004	SACHET	10/01/2016	CHIRURGIE			
<input type="checkbox"/> ELEVATEUR DROIT LARGE COURT	000 000 355 005	SACHET	10/01/2016	CHIRURGIE			
<input type="checkbox"/> CAVIERS BAS MOLATRE	000 000 355 006	SACHET	10/01/2016	CHIRURGIE			

Sélection

 Sauver le cycle  Annuler

⇒ Dans un cycle de stérilisation

⇒ Possibilité de sélectionner plusieurs articles et de les enlever en même temps

⇒ Par un clic sur la flèche verte dirigée vers la gauche

6 articles contenus dans le cycle

	Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date d'utilisation	Patient
<input type="checkbox"/>	DAVIER HAUT MOLLAIRE	000 000 354 002	SACHET	30/12/2015	CHIRURGIE			
<input checked="" type="checkbox"/>	SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 354 003	SACHET	30/12/2015	CHIRURGIE		08/10/2015	R
<input checked="" type="checkbox"/>	SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 354 004	SACHET	30/12/2015	CHIRURGIE		07/10/2015	L
<input checked="" type="checkbox"/>	ELEVATEUR DROIT LARGE COURT	000 000 354 005	SACHET	30/12/2015	CHIRURGIE		12/10/2015	G
<input type="checkbox"/>	ELEVATEUR DROIT FIN	000 000 354 001	SACHET	30/12/2015	CHIRURGIE			
<input type="checkbox"/>	ELEVATEUR COURBE LARGE	000 000 354 006	SACHET	30/12/2015	CHIRURGIE			



Sauver le cycle



Annuler

⇒ Chaque article contenu dans le cycle permet de savoir

- ⇒ Pour quel type d'actes l'article a été utilisé
- ⇒ Le praticien qui a utilisé l'article
- ⇒ La date d'utilisation de l'article
- ⇒ Le patient pour lequel l'article a été utilisé

6 articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date d'utilisation	Patient
<input type="checkbox"/> DAVIER HAUT MOLLAIRE	000 000 354 002	SACHET	30/12/2015	CHIRURGIE			
<input checked="" type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 354 003	SACHET	30/12/2015	CHIRURGIE		08/10/2015	R
<input checked="" type="checkbox"/> SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 354 004	SACHET	30/12/2015	CHIRURGIE		07/10/2015	L
<input checked="" type="checkbox"/> ELEVATEUR DROIT LARGE COURT	000 000 354 005	SACHET	30/12/2015	CHIRURGIE		12/10/2015	C
<input type="checkbox"/> ELEVATEUR DROIT FIN	000 000 354 001	SACHET	30/12/2015	CHIRURGIE			
<input type="checkbox"/> ELEVATEUR COURBE LARGE	000 000 354 006	SACHET	30/12/2015	CHIRURGIE			



Sauver le cycle




Annuler

⇒ En bout de champ des titres

⇒ Un icône petite liste

⇒ Un clic ou un clic droit permet de copier ou d'exporter la liste des articles du cycle

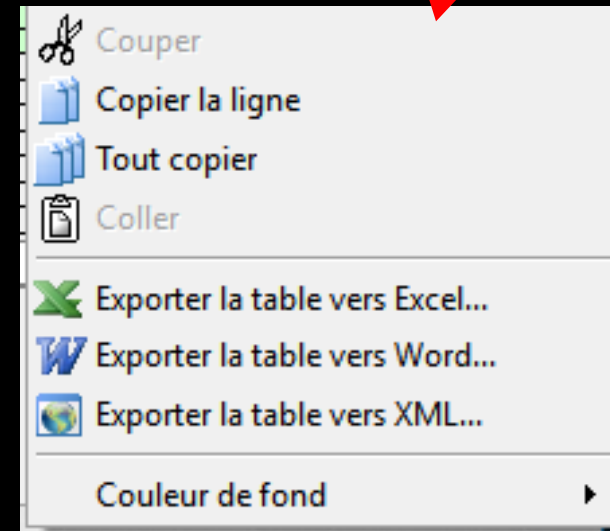


Dans la partie supérieure une barre d'icônes




⇒ Imprimer la fiche du cycle

⇒ Pour imprimer la fiche du cycle sélectionné

Clic droit donne une prévisualisation avant impression

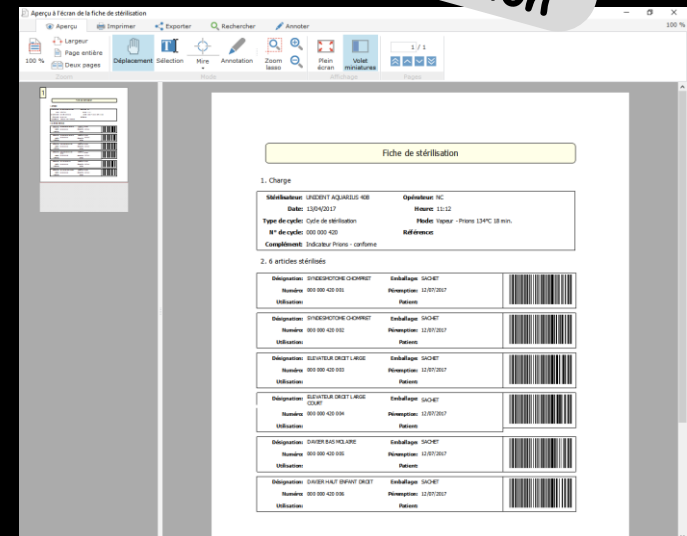

Dans la partie supérieure une barre d'icônes

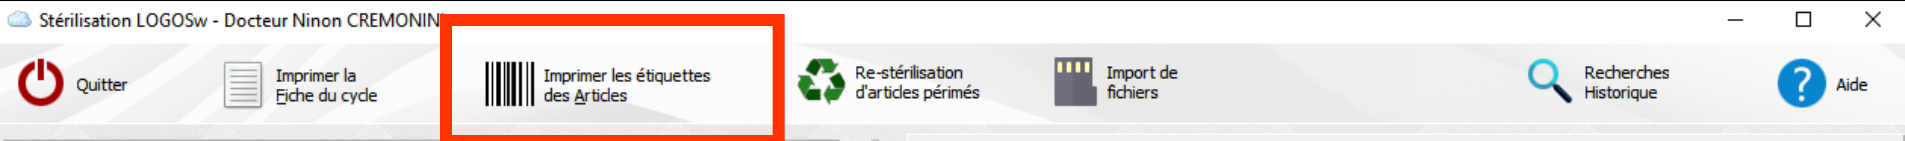

⇒ Imprimer les étiquettes des articles



⇒ Pour imprimer les étiquettes des codes barres des articles qui ont été stérilisés

⇒ Les étiquettes seront alors collées sur les articles stérilisés

⇒ Clic sur l'icône

⇒ Ouverture de la
fenêtre


On va effectuer le
paramétrage
de l'imprimante et des
étiquettes

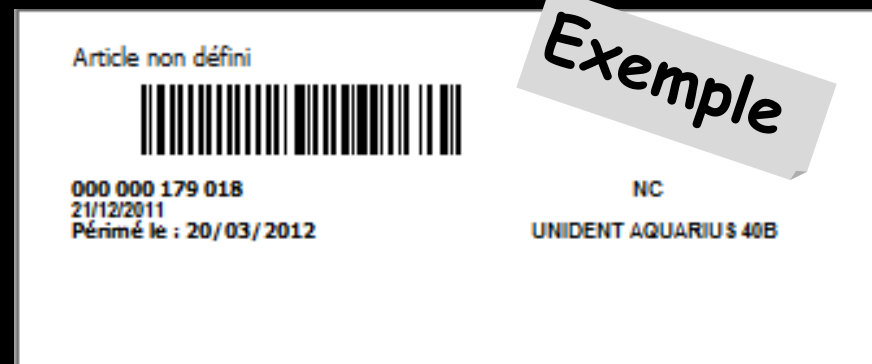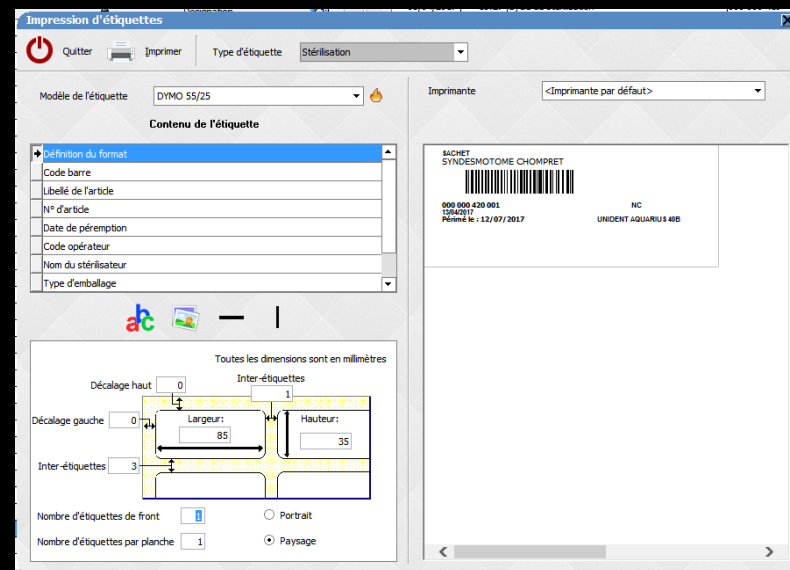


Voir "Paramétrage
des étiquettes"

Choix de l'imprimante

- ⇒ Soit l'imprimante habituelle du cabinet avec des planches d'étiquettes autocollantes
- ⇒ Soit une imprimante à étiquettes style Dymo

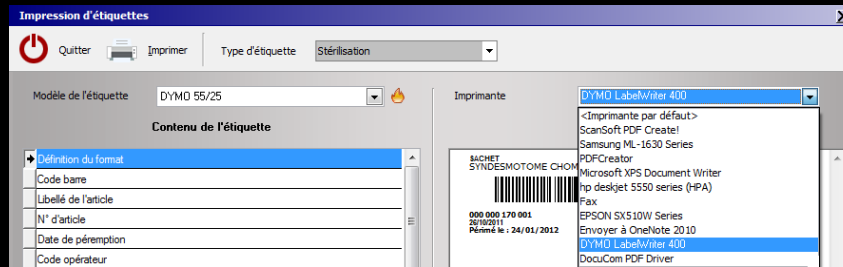

- ⇒ Le modèle d'étiquettes codes barres est celui des imprimantes Dymo 55/25

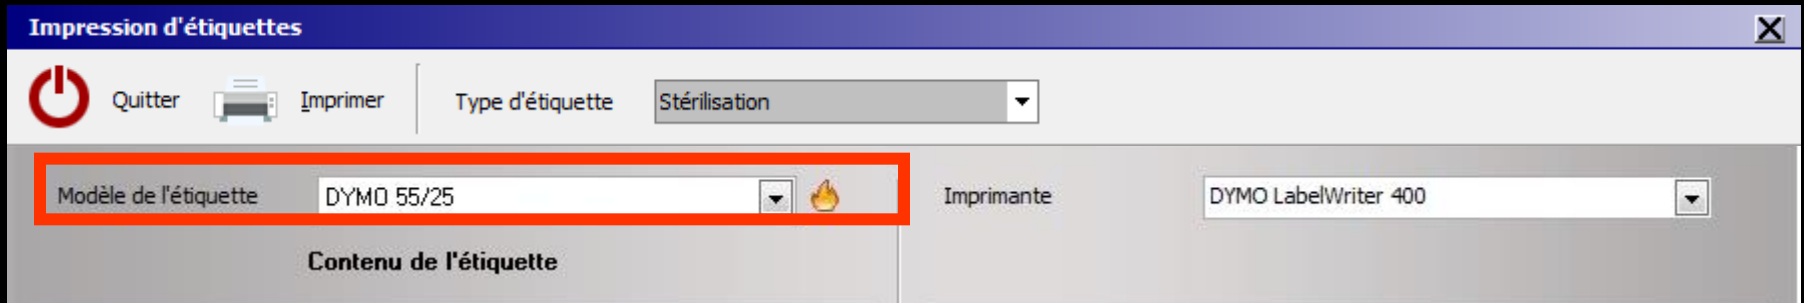


Paramétrage des étiquettes

- ⇒ Le paramétrage se fait la première fois
- ⇒ Si on ne change pas le format d'étiquettes, il reste enregistré pour les étiquettes à imprimer pour chaque cycle de stérilisation


Impression des étiquettes

⇒ Le cycle de stérilisation terminé et tout étant conforme

⇒ Impression des étiquettes codes barres

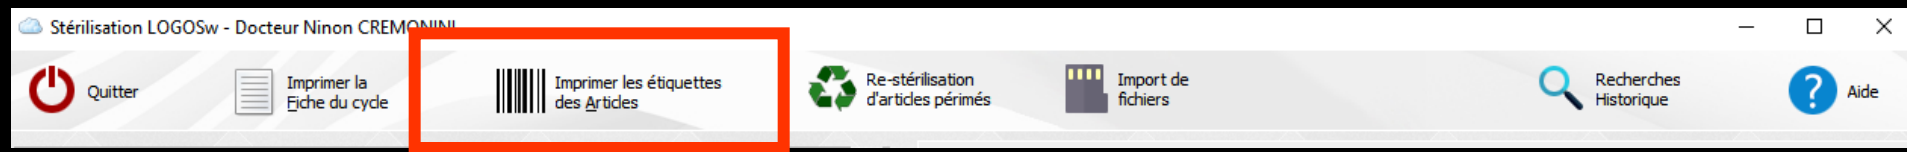

Toutes les étiquettes de tous les articles contenus dans le cycle de stérilisation sélectionné seront imprimées

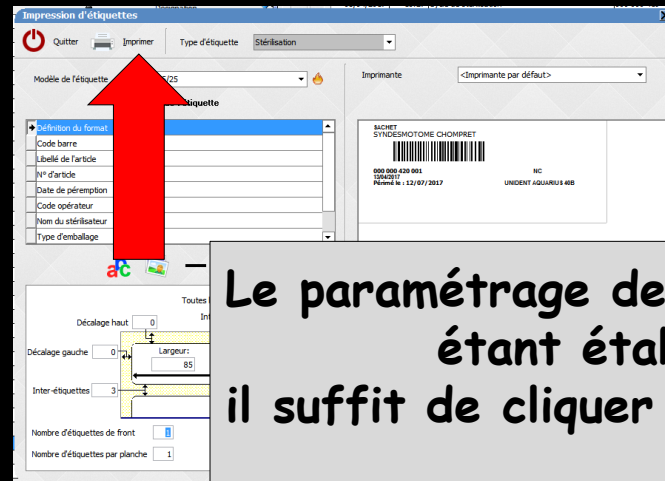

Le paramétrage des étiquettes étant établi, il suffit de cliquer sur imprimer

- ⇒ Si on ne veut imprimer qu'une seule étiquette (étiquette à refaire par exemple)
- ⇒ Après sélection du cycle de stérilisation
- ⇒ **Clic droit** sur l'article dont l'étiquette est à refaire
- ⇒ Clic sur "Imprimer l'étiquette"

	Désignation	Numéro	Emballage
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVIER HAUT PREMIERE	000 000 008 001	SACHET
<input type="checkbox"/>	DAVIER MOL		
<input type="checkbox"/>	SYNDES TOME	000 000 008 003	SACHET
<input checked="" type="checkbox"/>	SYNDES TOME	000 000 008 004	SACHET

Annotations de l'image :


- Un bouton "Imprimer l'étiquette" est superposé sur la deuxième ligne du tableau.
- Un bouton "Clic" est superposé sur la quatrième ligne du tableau.
- Un bouton "Clic droit" est superposé sur la première colonne de la première ligne.
- Des flèches rouges pointent de ces boutons vers les éléments correspondants dans le tableau.

Cycle de stérilisation

- ⇒ Aucun intérêt d'imprimer les étiquettes avant la stérilisation
- ⇒ Si le cycle est à refaire pour quelque raison que ce soit, il faudrait jeter les étiquettes et refaire une impression avec les paramètres du nouveau cycle

Import des données d'une carte

⇒ Pour importer un fichier d'une carte

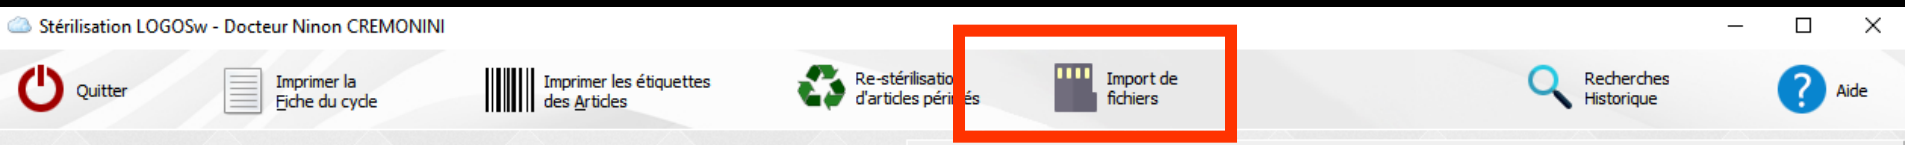

Traçabilité en fiche patient

⇒ L'idéal est de disposer d'une douchette, lecteur de codes barres



En fin de séance de soins

- ⇒ On rentre les actes effectués
- ⇒ On scanne les codes-barres des différents sachets ouverts

La douchette enregistre
Émission de BIP



La traçabilité
est terminée

⇒ La ligne bureautique est créée

05/04/2017	09:10	EXTV	Extraction dents définitives	34 43	HBGD043	50.16 €	©	Articles de stérilisation: 000 000 417 004 - 000 000 418 018 - 000 000 417 002	NC
05/04/2017	09:11								NC

- ⇒ Pour éviter les erreurs de saisie
- ⇒ Si par inadvertance on re-scane une étiquette déjà enregistrée
- ⇒ Message d'erreur

À partir de la fiche patient

⇒ **Sans douchette**, il est possible de saisir manuellement les articles stérilisés

⇒ Après avoir saisi les actes


26/04/2017	17:32	EXTD1	Extraction dent définitive	46	HBGD036	33.44 €	S	NC
------------	-------	-------	----------------------------	----	---------	---------	---	----

APRIA RSA jusqu'au 31/12/2017 Aucun autre rendez-vous fixé

Date	26/04/2017 17:32	Acte	EXTD1 Extraction dent définitive	Cotation	HBGD036	Honoraires	33,44 €	Oppos.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dents	46	Qualification	-	CPAM AMO	23,41	APRIA RSA		Traçabilité de la stérilisation	[Ctrl+A]
Réglé	<input type="checkbox"/>	Feuille	S Feuille dentaire à faire	Exonération	-				
Lieu	Cabinet	Arrêt de travail	<input type="checkbox"/> jours						
Matériaux	<input type="text"/>								
Commentaire	<input type="text"/>								


praticien NC

⇒ Clic sur l'icône de stérilisation

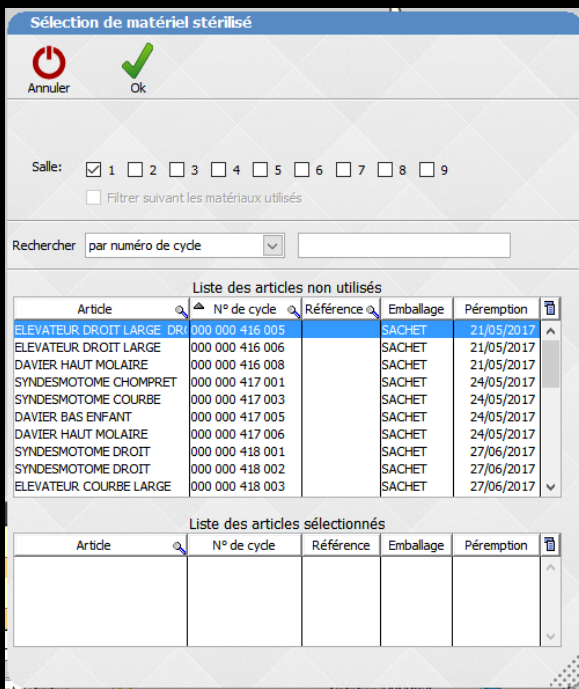

⇒ Dans la fenêtre de stérilisation qui s'ouvre

⇒ Dans la partie haute de la fenêtre qui répertorie tout ou une partie (si filtrage) des articles stérilisés en stock, on double clique sur les articles utilisés

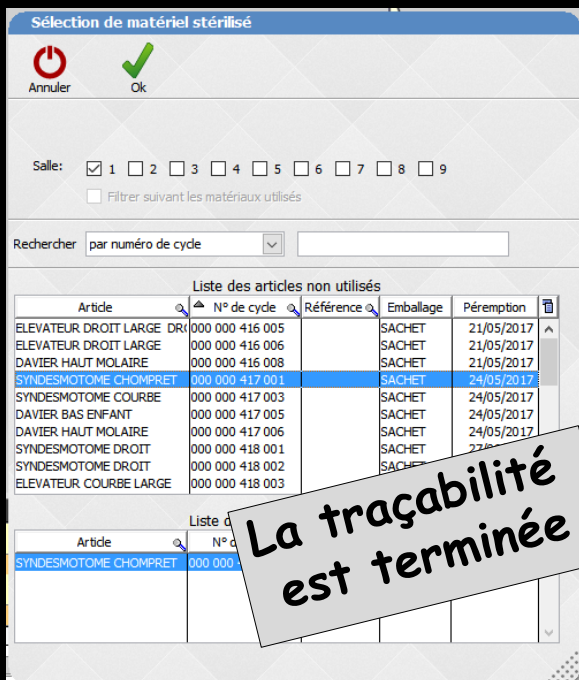

⇒ Les articles utilisés apparaissent dans la partie basse

⇒ On valide en cliquant sur Ok

⇒ La fenêtre se referme

⇒ Ou fermeture automatique de la fenêtre après X secondes

⇒ La ligne bureautique est créée

La traçabilité est terminée

Filtrages possibles



⇒ Par salle

⇒ On peut sélectionner les articles stérilisés

⇒ Par numéro de cycle

⇒ Par référence de stérilisation

Sélection de matériel stérilisé

 
Annuler Ok

Salle: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Filtrer suivant les matériaux utilisés

Rechercher

 les non utilisés

Article	N° de cycle	Référence	Emballage	Péremption
ELEVATEUR DROIT LARGE DR	000 000 416 005		SACHET	21/05/2017
ELEVATEUR DROIT LARGE	000 000 416 006		SACHET	21/05/2017
DAVIER HAUT MOLAIRE	000 000 416 008		SACHET	21/05/2017
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 417 001		SACHET	24/05/2017
SYNDESMOTOME COURBE	000 000 417 003		SACHET	24/05/2017
DAVIER BAS ENFANT	000 000 417 005		SACHET	24/05/2017
DAVIER HAUT MOLAIRE	000 000 417 006		SACHET	24/05/2017
SYNDESMOTOME DROIT	000 000 418 001		SACHET	27/06/2017
SYNDESMOTOME DROIT	000 000 418 002		SACHET	27/06/2017
ELEVATEUR COURBE LARGE	000 000 418 003		SACHET	27/06/2017

Liste des articles sélectionnés

Article	N° de cycle	Référence	Emballage	Péremption
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 417 001		SACHET	24/05/2017

À partir de la fiche patient

⇒ La possibilité de saisie manuelle reste cependant indispensable à la correction éventuelle d'erreurs, comme la saisie d'un sachet finalement non-ouvert ou l'oubli d'un sachet que l'on aurait détruit avant de lire son code-barres...

Sélection de matériel stérilisé

Annuler Ok

Salle: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Filtrer suivant les matériaux utilisés

Rechercher par numéro de cycle

Liste des articles non utilisés

Article	N° de cycle	Référence	Emballage	Péréemption	
ELEVATEUR DROIT LARGE DR	000 000 416 005		SACHET	21/05/2017	▲
ELEVATEUR DROIT LARGE	000 000 416 006		SACHET	21/05/2017	
DAVIER HAUT MOLLAIRE	000 000 416 008		SACHET	21/05/2017	
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 417 001		SACHET	24/05/2017	
SYNDESMOTOME COURBE	000 000 417 003		SACHET	24/05/2017	
DAVIER BAS ENFANT	000 000 417 005		SACHET	24/05/2017	
DAVIER HAUT MOLLAIRE	000 000 417 006		SACHET	24/05/2017	
SYNDESMOTOME DROIT	000 000 418 001		SACHET	27/06/2017	
SYNDESMOTOME DROIT	000 000 418 002		SACHET	27/06/2017	
ELEVATEUR COURBE LARGE	000 000 418 003		SACHET	27/06/2017	▼

Liste des articles sélectionnés

Article	N° de cycle	Référence	Emballage	Péréemption	
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 417 001		SACHET	24/05/2017	▲

Clic droit
pour supprimer


Double clic
pour rajouter un article



Dans la fiche patient

05/04/2017 09:10	EXTV	Extraction dents définitives	34 43	HGD043	50.16 €	©	Articles de stérilisation: 000 000 417 004 - 000 000 418 018 - 000 000 417 002	NC
05/04/2017 09:11								NC

- ⇒ Pour éviter une fausse manœuvre ☹(((
- ⇒ Suppression d'une ligne de stérilisation par erreur
- ⇒ Message de demande de confirmation

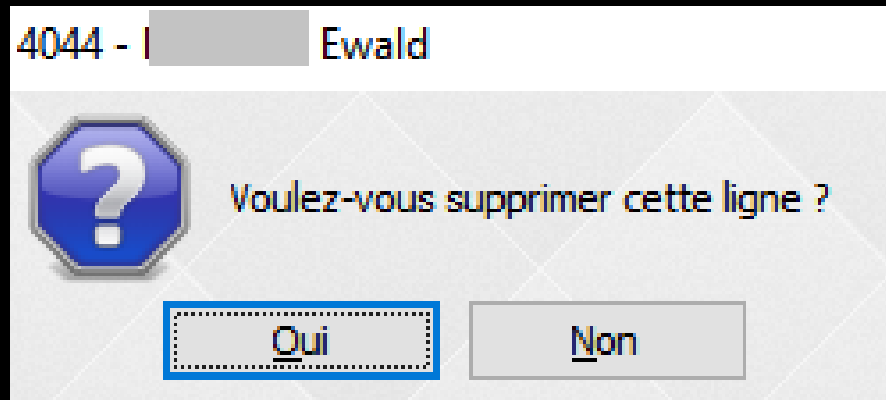

Dans la fiche patient

05/04/2017	09:10	EXTV	Extraction dents définitives	34 43	HBGD043	50.16 €	©	Articles de stérilisation: 000 000 417 004 - 000 000 418 018 - 000 000 417 002	NC
05/04/2017	09:11								NC

⇒ Solution de rattrapage :

⇒ Si on a fait une erreur de fiche

⇒ Dans ce cas il faut supprimer la ligne bureautique de stérilisation

⇒ Les articles correspondants sont représentés de nouveau au choix pour un autre patient

Dans la fiche patient

05/04/2017 09:10	EXTV	Extraction dents définitives	34 43	HBGD043	50.16 €	Articles de stérilisation: 000 000 417 004 - 000 000 418 018 - 000 000 417 002	NC
05/04/2017 09:11							NC

⇒ On peut afficher ou non cette ligne bureautique

Tous les actes	
(amique) - Panoramique : PANORAMIQUE DU 03/04/2017	NC
RE ARRÊT DU PREVISCAN PAR MEDECIN TRAITANT ET	NC
VEC ACCORD POUR EXTRACTIONS	NC
417 004 - 000 000 418 018 - 000 000 417 002	NC

Paramétrage de l'affichage des actes

Enregistrer Annuler Nom de la présentation des actes : Tous les actes
 Utiliser cette vue à l'ouverture

Regrouper par date Déployer toutes les dates Colorer les lignes Police grande taille

Toutes Aucune Lignes bureautiques visualisées

Afficher	Type de ligne	Couleur
<input checked="" type="checkbox"/>	Actes réglés et actes gratuits	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	Actes non réglés	Cyan
<input checked="" type="checkbox"/>	Colonne lorsque la feuille est faite	Cyan
<input checked="" type="checkbox"/>	Colonne lorsqu'il n'y a pas de feuille à faire	Cyan
<input checked="" type="checkbox"/>	Courriers	Cyan
<input checked="" type="checkbox"/>	Compte-rendus	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	Documents	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	Formulaires personnalisés	Cyan
<input checked="" type="checkbox"/>	Ordonnances	Orange
<input checked="" type="checkbox"/>	Devis	Cyan
<input checked="" type="checkbox"/>	Demandes d'entente préalable	Cyan
<input checked="" type="checkbox"/>	Feuilles SS	Vert
<input checked="" type="checkbox"/>	Fiches de laboratoire	Vert
<input checked="" type="checkbox"/>	Raccourcis	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	Factures	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	Rendez-vous	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	Couleur pour les rendez-vous manqués	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	Couleur pour les rendez-vous annulés	Rouge
<input checked="" type="checkbox"/>	Couleur pour les rendez-vous reportés	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	Echéanciers de règlement	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	Questionnaires médicaux	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	Prises de teinte	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	Articles de stérilisation	Grise
<input checked="" type="checkbox"/>	Emails	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	SMS	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	Analyse céphalométrique	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	Schéma dentaire	Jaune
<input checked="" type="checkbox"/>	Règlements et RSP	Jaune
<input type="checkbox"/>	Charte parodontale	Noir

Choisir la couleur d'affichage

Couleurs

Couleurs de base :

Couleurs personnalisées :

Teinte : 160 Rouge : 224
Satur. : 0 Vert : 224
Lum. : 211 Bleu : 224

CouleurUnie Lum. : 211 Bleu : 224

OK Annuler Ajouter aux couleurs personnalisées

Dans la fiche patient

05/04/2017	09:10	EXTV	Extraction dents définitives	34 43	HBGD043	50.16 €	©	Articles de stérilisation: 000 000 417 004 - 000 000 418 018 - 000 000 417 002	NC
05/04/2017	09:11								NC

- ⇒ Possibilité de mettre dans une fiche patient en une seule fois (une seule ligne bureautique) : 15 sachets de stérilisation (250 caractères soit 15 articles maxi par ligne)
- ⇒ On peut scanner des articles en plusieurs fois dans la même séance et n'avoir toujours qu'une seule ligne bureautique
- ⇒ Au delà de 15 articles, une nouvelle ligne bureautique se crée

Dans la fiche patient

05/04/2017	09:10	EXTV	Extraction dents définitives	34 43	HBGD043	50.16 €	©	Articles de stérilisation: 000 000 417 004 - 000 000 418 018 - 000 000 417 002	NC
05/04/2017	09:11								NC

⇒ Un double clic sur la ligne de stérilisation ouvre la fenêtre de stérilisation détaillée

Stérilisation LOGOS_w

Quitter 23 Imprimer la liste des instruments utilisés pour le rendez-vous Imprimer la liste de tous les instruments utilisés pour le patient Imprimer la Fiche du cycle sélectionné

Liste des stérilisations

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	000 000 417	
29/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	000 000 418	

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date: 23/02/2017 Heure: 14:14

N° de cycle : 000 000 417 Référence :

Complément : Indicateur Prions - conforme

Documents : 417.pdf

2 articles correspondants et contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péréemption
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 417 002	SACHET	24/05/2017
ELEVATEUR DROIT LARGE COURT	000 000 417 004	SACHET	24/05/2017

À partir de la ligne bureautique de stérilisation dans la fiche patient

⇒ Possibilité

⇒ D'imprimer la liste des instruments utilisés pour le RDV

⇒ Un clic droit donnant un aperçu de l'impression

Stérilisation **LU005_W**

Imprimer la liste des instruments utilisés pour le rendez-vous

Imprimer la liste de tous les instruments utilisés pour le patient

Imprimer la Fiche du cycle sélectionné

Liste des stérilisations

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	000 000 417	
29/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	000 000 418	

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle : Cycle de stérilisation Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date : 23/02/2017 Heure : 14:14

N° de cycle : 000 000 417 Référence :

Complément : Indicateur Prions - conforme

Documents : 417.pdf

2 articles correspondants et contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péréption
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 417 002	SACHET	24/05/2017
ELEVATEUR DROIT LARGE COURT	000 000 417 004	SACHET	24/05/2017

LIEN des instruments utilisés pour le

Désignation : SYNDESMOTOME CHOMPRET Numéro : 000 000 417 002 Emballage : SACHET

Date de fabrication : 05/04/2017 Date de stérilisation : 24/02/2017

Date de fabrication : 05/04/2017 Date de stérilisation : 14/14

Mode de stérilisation : UNIDENT AQUARIUS 40B Type de cycle : Cycle de stérilisation

Prions : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Ref. Cycle :

Nombre de cycles : 000 000 4

Complément : Indicateur Prions - conforme

Désignation : ELEVATEUR DROIT LARGE COURT Numéro : 000 000 417 004 Emballage : SACHET

Date de fabrication : 05/04/2017 Date de stérilisation : 24/02/2017

Date de fabrication : 05/04/2017 Date de stérilisation : 14/14

Mode de stérilisation : UNIDENT AQUARIUS 40B Type de cycle : Cycle de stérilisation

Prions : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Ref. Cycle :

Nombre de cycles : 000 000 4

Complément : Indicateur Prions - conforme

Désignation : ELEVATEUR DROIT LARGE COURT Numéro : 000 000 417 004 Emballage : SACHET

Date de fabrication : 05/04/2017 Date de stérilisation : 24/02/2017

Date de fabrication : 05/04/2017 Date de stérilisation : 14/14

Mode de stérilisation : UNIDENT AQUARIUS 40B Type de cycle : Cycle de stérilisation

Prions : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Ref. Cycle :

Nombre de cycles : 000 000 4

Complément : Indicateur Prions - conforme

À partir de la ligne bureautique de stérilisation dans la fiche patient

⇒ Possibilité

⇒ D'imprimer la liste de tous les instruments utilisés pour le patient

⇒ Un clic droit donnant un aperçu de l'impression

Stérilisation LOGOS_w

Imprimer la liste des instruments utilisés pour le rendez-vous

Imprimer la liste de tous les instruments utilisés pour le patient

Imprimer la Fiche du cycle sélectionné

Liste des stérilisations

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	000 000 417	
29/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	000 000 418	

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle : Cycle de stérilisation Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date : 23/02/2017 Heure : 14:14

N° de cycle : 000 000 417 Référence :

Complément : Indicateur Prions - conforme

Documents : 417.pdf

2 articles correspondants et contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péréemption
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 417 002	SACHET	24/05/2017
ELEVATEUR DROIT LARGE COURT	000 000 417 004	SACHET	24/05/2017

Liste des instruments utilisés

Désignation	Numéro	Date de péréemption	Date de stérilisation	Heure de stérilisation	Type de cycle	Opérateur
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 417 002	24/05/2017	23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	NC
ELEVATEUR DROIT LARGE COURT	000 000 417 004	24/05/2017	29/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	NC
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 417 002	24/05/2017	23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	NC

À partir de la ligne bureautique de stérilisation dans la fiche patient

⇒ Possibilité

- ⇒ D'imprimer la fiche du cycle sélectionné
- ⇒ Un clic droit donnant un aperçu de l'impression

Stérilisation LOGOS_w

Quitter 23 Imprimer la liste des instruments utilisés pour le rendez-vous Imprimer la liste de tous les instruments utilisés pour le patient Imprimer la Fiche du cycle sélectionné

Liste des stérilisations

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	000 000 417	
29/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	000 000 418	

Opérateur : NC Stérilisateur: UNIDENT AQUARIUS 40B

Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode: Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Date: 23/02/2017 Heure: 14:14

N° de cycle: 000 000 417 Référence:

Complément: Indicateur Prions - conforme

Documents: 417.pdf

2 articles correspondants et contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption
SYNDEMOTOME CHOMPRET	000 000 417 002	SACHET	24/05/2017
ELEVATEUR DROIT LARGE COURT	000 000 417 004	SACHET	24/05/2017

Aperçu à l'écran de la fiche de stérilisation

Fiche de stérilisation

1. Charge

Stérilisateur: UNIDENT AQUARIUS 40B	Opérateur: NC
Date: 23/02/2017	Heure: 14:14
Type de cycle: Cycle de stérilisation	Mode: Vapeur - Prions 134°C 18 min.
N° de cycle: 000 000 417	Référence:
Complément: Indicateur Prions - conforme	

2. Articles stérilisés

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisation
SYNDEMOTOME CHOMPRET	000 000 417 002	SACHET	24/05/2017	Prions
ELEVATEUR DROIT LARGE COURT	000 000 417 004	SACHET	24/05/2017	Prions

Cycle de stérilisation

- ⇒ Chaque fois qu'un article a été utilisé, il est coché indiquant qu'il a été utilisé
- ⇒ Les articles utilisés disparaissent au fur et à mesure de la liste des articles utilisables

The screenshot displays the LOGOSw software interface for sterilization management. The window title is "Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI".

Left Panel: Traçabilité complète

Buttons: Quitter, Imprimer la Fiche du cycle, Imprimer les étiquettes des articles, Re-stérilisation d'articles périmés, Import de fichiers, Recherches Historique, Aide.

Section: **Traçabilité complète**

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation
Instrument	ARRACHE COURONNE
Instrument	CISEAU
Instrument	CISEAUX A SUTURES
Instrument	KONTRE ANGLE BLEU
Instrument	KONTRE ANGLE ROUGE
Instrument	KONTRE ANGLE VERT
Instrument	CLRETTE
Instrument	DAVIER BAS ENFANT
Instrument	DAVIER BAS INCISIVE
Instrument	DAVIER BAS MOLAIRE
Instrument	DAVIER BAS PREMOLAIRE
Instrument	DAVIER BAS RACINE
Instrument	DAVIER HAUT ENFANT COURBE
Instrument	DAVIER HAUT ENFANT DROIT
Instrument	DAVIER HAUT INCISIVE
Instrument	DAVIER HAUT MOLAIRE
Instrument	DAVIER HAUT PREMOLAIRE
Instrument	DAVIER HAUT RACINE
Instrument	ELEVATEUR COURBE
Instrument	ELEVATEUR COURBE FIN
Instrument	ELEVATEUR COURBE LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT FIN
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE COURT
Instrument	ELEVATEUR DROIT LARGE GAUCHE
Instrument	EXCAVATEUR
Instrument	INSERT EMS DET
Regroupement	KIT ENDO
Regroupement	KIT EXAMEN SIMPLE
Regroupement	KIT SOINS
Instrument	MANCHE SCALPEL
Instrument	MIROIR
Instrument	PIECE A MAIN

Buttons: Créer, Modifier, Supprimer

Traçabilité simplifiée

Right Panel: Liste des stérilisations

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence
25/04/2017	16:48	Cycle de stérilisation	000 000 421	
13/04/2017	11:12	Cycle de stérilisation	000 000 420	
05/04/2017	18:27	Cycle de stérilisation	000 000 419	
29/03/2017	18:06	Cycle de stérilisation	000 000 418	
23/02/2017	14:14	Cycle de stérilisation	000 000 417	
20/02/2017	14:39	Cycle de stérilisation	000 000 416	
06/02/2017	11:43	Cycle de stérilisation	000 000 415	
30/01/2017	14:54	Cycle de stérilisation	000 000 414	
24/01/2017	17:36	Cycle de stérilisation	000 000 413	
17/01/2017	15:37	Cycle de stérilisation	000 000 412	
05/01/2017	18:26	Cycle de stérilisation	000 000 411	
20/12/2016	15:28	Cycle de stérilisation	000 000 410	
14/12/2016	13:21	Cycle de stérilisation	000 000 409	
17/11/2016	11:39	Cycle de stérilisation	000 000 408	
09/11/2016	15:45	Cycle de stérilisation	000 000 407	

Buttons: Créer un cycle, Modifier le cycle, Invalider le cycle, Supprimer le cycle

Opérateur : NC Stérilisateur : UNIDENT AQUIARIUS 408

Type de cycle: Cycle de stérilisation Mode : Vapeur - Prone 134°C 18 mn.

Date: 05/04/2017 Heure : 18:27

N° de cycle : 000 000 419 Référence :

Complément :

Documents : 420.pdf

8 articles contenus dans le cycle

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Pratice	Date
ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT	000 000 419 005	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE		
DAVIER BAS PREMOLAIRE	000 000 419 006	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE		
DAVIER BAS MOLAIRE	000 000 419 007	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE		
DAVIER HAUT PREMOLAIRE	000 000 419 008	SACHET	04/07/2017	CHIRURGIE		

À l'ouverture du logiciel

- ⇒ Si des articles stérilisés seront périmés dans les 7 jours
- ⇒ Message d'alerte (alerte de péremption)
- ⇒ Avec possibilité d'imprimer la liste des articles

Alerte de péremption

ATTENTION 30 articles stérilisés vont être périmés dans les 7 jours à venir.

Articles correspondants

Désignation	Numéro	Ref. cycle	Emballage	Péremption
Article non défini	000 000 357 001			14/10/2015
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 357 002			14/10/2015
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 357 003			14/10/2015
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 357 004			14/10/2015
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 357 005			14/10/2015
DAVIER HAUT ENFANT DROIT	000 000 357 006			14/10/2015
ELEVATEUR DROIT LARGE COURT	000 000 357 007			14/10/2015
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 357 008			14/10/2015
DAVIER HAUT ENFANT DROIT	000 000 357 009			14/10/2015
ELEVATEUR DROIT LARGE COURT	000 000 357 010			14/10/2015

Stérilisez à nouveau ces articles afin qu'ils n'apparaissent plus dans cette liste.

De même si on ouvre le module de stérilisation directement, et non pas par LOGOSw

Alerte de péremption

ATTENTION 30 articles stérilisés vont être périmés dans les 7 jours à venir.

Articles correspondants

Désignation	Numéro	Ref. cycle	Emballage	Péremption
Article non défini	000 000 357 001			14/10/2015
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 357 002			14/10/2015
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 357 003			14/10/2015
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 357 004			14/10/2015
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 357 005			14/10/2015
DAVIER HAUT ENFANT DROIT	000 000 357 006			14/10/2015
ELEVATEUR DROIT LARGE COURT	000 000 357 007			14/10/2015
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 357 008			14/10/2015
DAVIER HAUT ENFANT DROIT	000 000 357 009			14/10/2015
ELEVATEUR DROIT LARGE COURT	000 000 357 010			14/10/2015




Stérilisez à nouveau ces articles afin qu'ils n'apparaissent plus dans cette liste.


La gestion des péremptions

- ⇒ Permet de gérer tous les articles stérilisés qui seront périmés
 - ⇒ Dans les 7 jours par défaut
 - ⇒ Dans "n" jours, pour prévoir les stérilisations à refaire
- ⇒ On aura ainsi, la liste des articles qui seront concernés par la péremption et devront être re-stérilisés

La gestion des péremptions

- ⇒ Pour obtenir la liste des instruments à ré-stériliser
- ⇒ Possibilité par "Recherches - Historique"

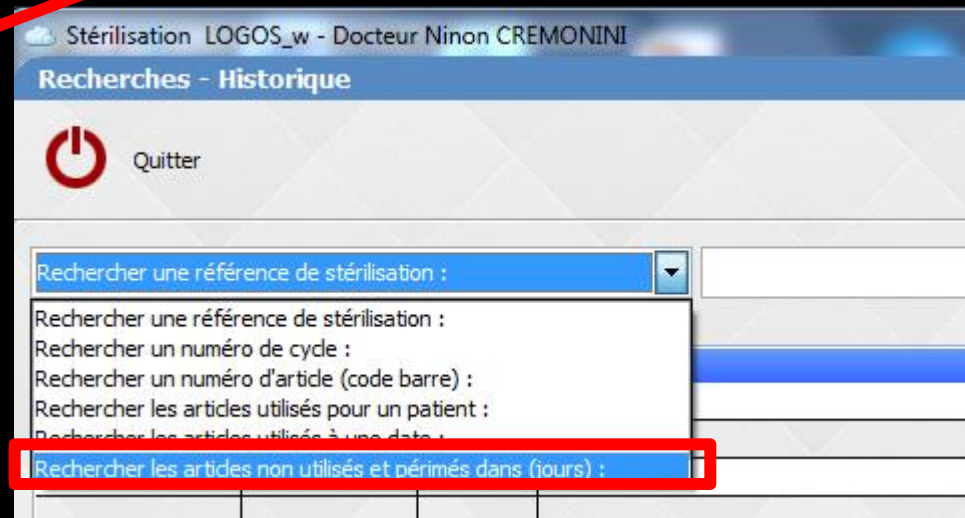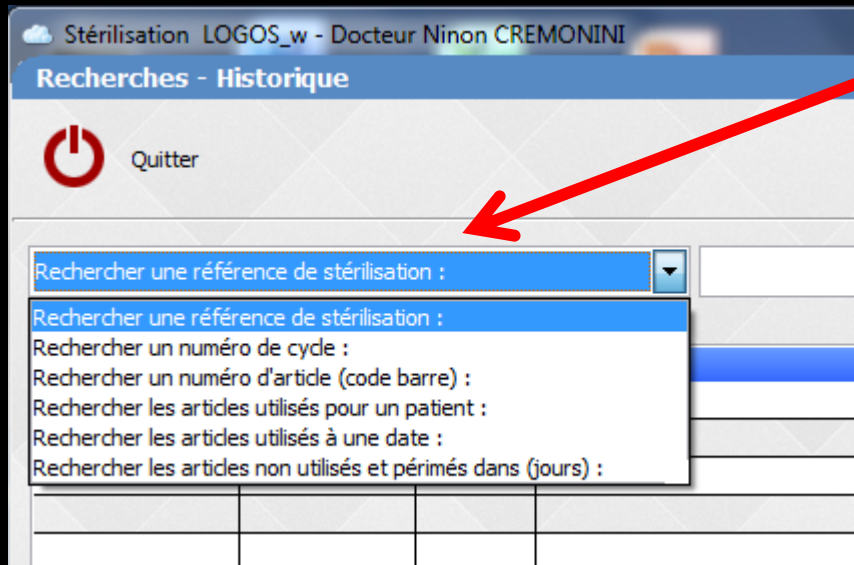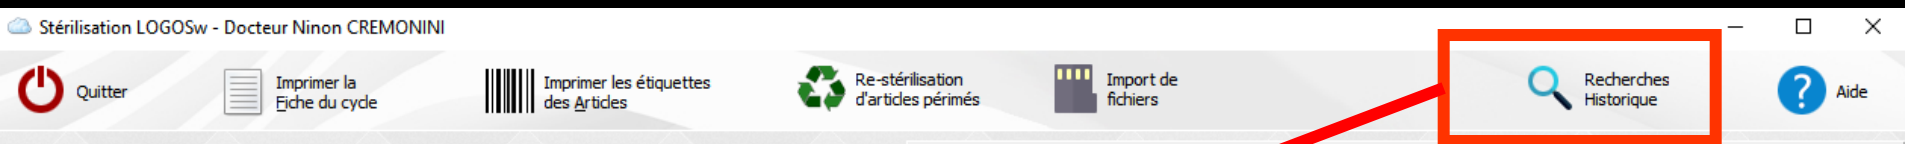

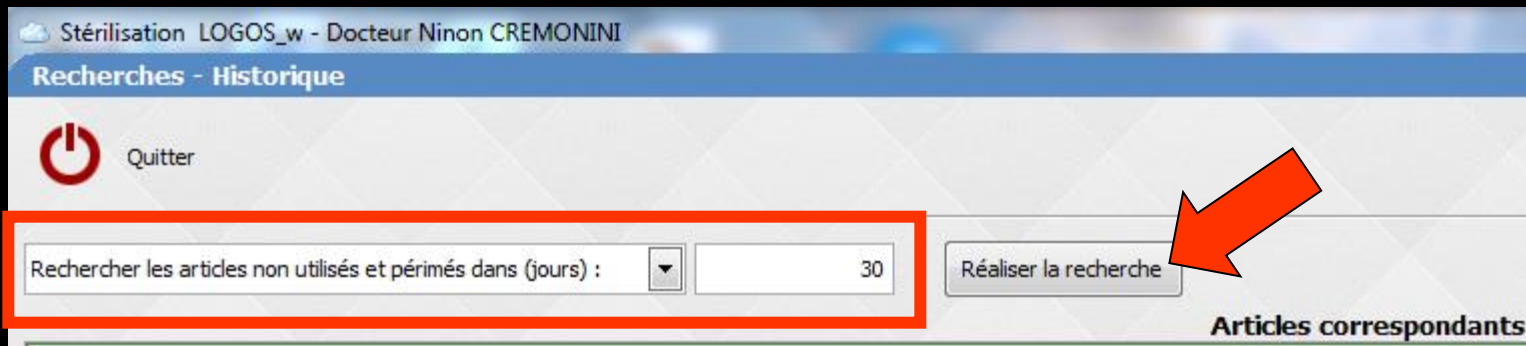



⇒ On met le nombre de jours désiré

⇒ Clic sur réaliser la recherche

Intégration	Niveau	Inf. Code	Intégration	Prevision
STÉRILISATION LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	2013/01/01
STÉRILISATION LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	2013/01/01
STÉRILISATION LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	2013/01/01
STÉRILISATION LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	2013/01/01
STÉRILISATION LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	2013/01/01
STÉRILISATION LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	2013/01/01
STÉRILISATION LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	2013/01/01
STÉRILISATION LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	LOGOS W	2013/01/01

⇒ Liste des instruments qui auront une date de péremption périmée et qui seront à re-stériliser dans "n" jours

Recherches - Historique

 Quitter
  Imprimer la liste des articles

Rechercher les articles non utilisés et périmés dans (jours) : Réaliser la recherche

Articles correspondants

Désignation
ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT
ELEVATEUR DROIT LARGE
DAVIER HAUT MOLAIRE

⇒ Clic sur **Imprimer la liste des articles** pour imprimer la liste

⇒ **Clic droit** pour avoir un aperçu avant impression de la liste des articles

Aperçu de l'impression

Aperçu Imprimer Exporter Rechercher Annoter
 Languer Page entière Deux pages Déplacement Sélection Mise en page Annotation Copier/coler Plan de l'écran Aide

100 % 1 / 1

20/04/2017

Liste des articles à re-stériliser avant le 25/06/2017

Désignation	Numéro	Ref. cycle	Emballage	Péremption
ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT	000 000 418 000		SACHET	21/05/2017
ELEVATEUR DROIT LARGE	000 000 418 000		SACHET	21/05/2017
DAVIER HAUT MOLAIRE	000 000 418 000		SACHET	24/05/2017
STINGESACTONE CHIFFRETT	000 000 417 001		SACHET	24/05/2017
STINGESACTONE COURBE	000 000 417 000		SACHET	24/05/2017
DAVIER BAS ENFANT	000 000 417 000		SACHET	24/05/2017
DAVIER HAUT MOLAIRE	000 000 417 000		SACHET	24/05/2017

Gestion des péremptions

- ⇒ Après avoir éditer la liste des articles à re-stériliser
- ⇒ On les recherche dans les tiroirs
- ⇒ On les prépare pour une autre stérilisation
- ⇒ On recrée un cycle de stérilisation avec ces instruments


Ensuite

- ⇒ Quand la re-stérilisation a été faite
- ⇒ On va dans "Re-stérilisation d'articles périmés" pour faire la gestion des péremptions



La gestion des péremptions

⇒ Pour obtenir la liste des instruments ré-stérilisés

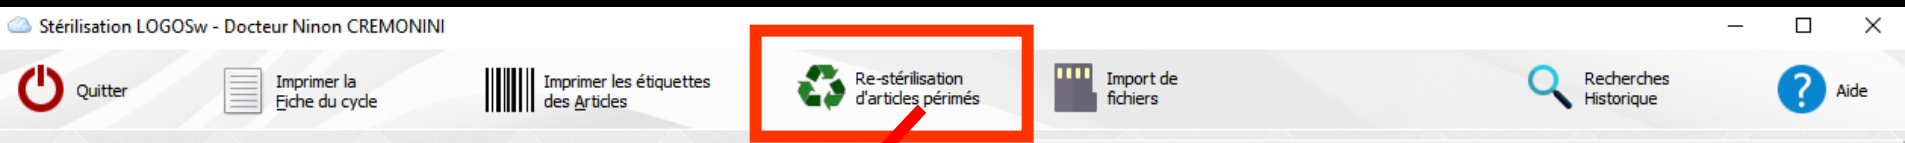

Gestion des péremptions

Rechercher les articles non utilisés et périmés dans (jours) : Réaliser la recherche

Re-stérilisation réalisée	Désignation	Numéro	Ref. cycle	Emballage	Péremption

Tout Aucun Ok Annuler Imprimer Afficher cette liste sur ce poste au démarrage de LOGOSw

Gestion des péremptions

⇒ On recherchera tous les articles qui ont été concernés par la péremption

Gestion des péremptions

Rechercher les articles non utilisés et périmés dans (jours) :

Re-stérilisation réalisée	Désignation	Numéro	Ref. cycle	Emballage	Péremption
<input type="checkbox"/>	ELEVATEUR DROIT LARGE DROIT	000 000 416 005		SACHET	21/05/2017
<input type="checkbox"/>	ELEVATEUR DROIT LARGE	000 000 416 006		SACHET	21/05/2017
<input type="checkbox"/>	DAVIER HAUT MOLAIRE	000 000 416 008		SACHET	21/05/2017
<input type="checkbox"/>	SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 417 001		SACHET	24/05/2017
<input type="checkbox"/>	SYNDESMOTOME COURBE	000 000 417 003		SACHET	24/05/2017
<input type="checkbox"/>	DAVIER BAS ENFANT	000 000 417 005		SACHET	24/05/2017
<input type="checkbox"/>	DAVIER HAUT MOLAIRE	000 000 417 006		SACHET	24/05/2017

Tout Afficher cette liste sur ce poste au démarrage de LOGOSw

Gestion des péremptions

Validé dans (jours) :

60

Réaliser la recherche

Re-stérilisation réalisée	Désignation	Numéro	Ref. cycle	Emballage	Péremption
<input checked="" type="checkbox"/>					21/05/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	ELEVATEUR DROIT LARGE				21/05/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVIER HAUT MOLAIRE	000 000 416 008			21/05/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	SYNDESMOTOME CHOMPRET	000 000 417 001		SACHET	24/05/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	SYNDESMOTOME COURBE	000 000 417 003		SACHET	24/05/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVIER BAS ENFANT			SACHET	24/05/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVIER HAUT MOLAIRE			SACHET	24/05/2017

On coche les articles qui ont été re-stérilisés

On valide par clic sur Ok



Tout



Aucun

Ok

Annuler

Imprimer

Afficher cette liste sur ce poste au démarrage de LOGOSw

Gestion des péremptions

Rechercher les articles no

Re-stérilisation réalisée	Désignation	Numéro	Ref. cycle	Emballage	Péremption



Tout



Aucun

Ok


Annuler

Imprimer

Afficher cette liste sur ce poste au démarrage de LOGOSw

La liste est remise à jour

- ⇒ Un article stérilisé est proposé au choix aussi longtemps qu'il n'a pas été utilisé
- ⇒ Un article utilisé a une date d'utilisation et un numéro de patient
- ⇒ Pour qu'un instrument périmé sans date d'utilisation et de numéro de patient ne soit plus représenté au choix
 - ⇒ Il faut indiquer qu'on l'enlève puisque pour une raison X il a été re-stérilisé
 - ⇒ L'article est ainsi enlevé des articles stérilisés utilisables



Quitter



Imprimer la
Fiche du cycle



Imprimer les étiquettes
des Articles



Re-stérilisation
d'articles périmés



Import de
fichiers



Recherches
Historique



Aide

Recherches - Historique

Recherches - Historique



Quitter

Rechercher une référence de stérilisation :



Réaliser la recherche

Rechercher une référence de stérilisation :

Rechercher un numéro de cycle :

Rechercher un numéro d'article (code barre) :

Rechercher les articles utilisés pour un patient :


Rechercher les articles utilisés à une date :

Rechercher les articles non utilisés et périmés dans (jours) :

Liste des stérilisations

Stérilisateur

Permet également d'autres recherches



Quitter



Imprimer la
Fiche du cycle



Imprimer les étiquettes
des Articles



Re-stérilisation
d'articles périmés



Import de
fichiers



Recherches
Historique



Aide

⇒ Recherches historique

⇒ Par référence de stérilisation

⇒ Par numéro de cycle

⇒ Par code barre

⇒ Par articles utilisés pour un patient

⇒ Par date

⇒ Par article non utilisé et périmé dans (n) jours

The screenshot shows the 'Recherches - Historique' window. At the top, there is a search bar labeled 'Rechercher une référence de stérilisation' and a button 'Ajouter la recherche'. Below this is a table titled 'Liste des stérilisations' with columns: Date, Heure, Opérateur, Désinfectant, Référence, N° de cycle, and Temps de cycle. The table is currently empty. Below the table is a section titled 'Articles contenus dans le cycle' with columns: Désignation, Numéro d'article, Péremption, Patient, and Date d'utilisation. This section is also empty.

The screenshot shows the search dropdown menu. The search bar contains the text 'Rechercher une référence de stérilisation :'. The dropdown list contains the following options:

- Rechercher une référence de stérilisation :
- Rechercher un numéro de cycle :
- Rechercher un numéro d'article (code barre) :
- Rechercher les articles utilisés pour un patient :
- Rechercher les articles utilisés à une date :
- Rechercher les articles non utilisés et périmés dans (jours) :

Recherches - Historique

⇒ Recherche des instruments stérilisés dans un cycle donné

Rechercher un numéro de cycle : 354

Réaliser la recherche

Date	Stérilisateur	Référence	N° de cycle	Type de cycle
01/10/2015	15:07 NC UNIDENT AQUARIUS 408		000000354	Cycle de stérilisation

Liste des articles


Désignation	Numéro d'article	Péremption	Patient	Date d'utilisation
DAVIER HAUT MOLAIRE	000000354001	30/12/2015		
DAVIER HAUT MOLAIRE	000000354002	30/12/2015		
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000000354003	30/12/2015	RAI	08/10/2015
SYNDESMOTOME CHOMPRET	000000354004	30/12/2015	LT.	07/10/2015
ELEVATEUR DROIT LARGE COURT	000000354005	30/12/2015	GEF	12/10/2015

On rentre le n° du cycle recherché
Puis clic sur réaliser la recherche

N° de l'article
Date de péremption
Nom du patient
Date d'utilisation

Recherches - Historique

- ⇒ Recherche des articles stérilisés utilisés pour un patient donné
- ⇒ Clic sur l'ampoule
- ⇒ Sélection du patient puis **Ok**
- ⇒ Puis clic sur "Réaliser la recherche"

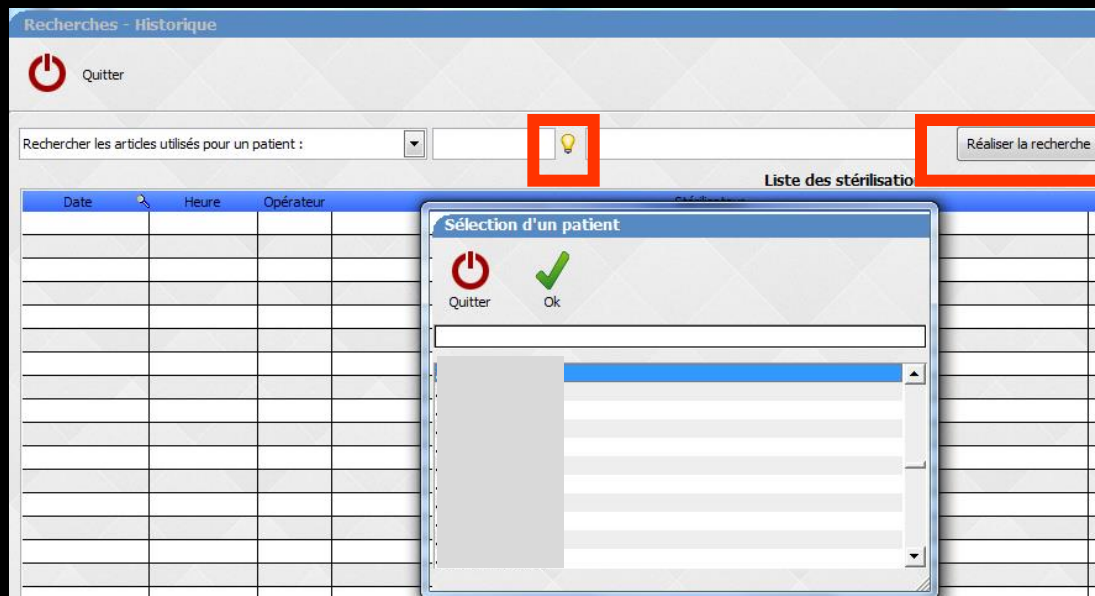

Recherches - Historique

Recherches - Historique

Quitter

Rechercher les articles non utilisés et périmés dans (jours) : Réaliser la recherche

Articles correspondants

Désignation	Numéro	Ref. cycle	Emballage	Péréemption
< Aucune réponse >				

- ⇒ Lorsqu'on lance une recherche
- ⇒ Quand pas de réponse
- ⇒ Message indiquant aucune réponse

Dans la partie supérieure une barre d'icônes



⇒ **Quitter**

⇒ Pour sortir du module de stérilisation

Temps nécessaire à la mise en œuvre de la traçabilité de la stérilisation

Traçabilité Complète :

- ⇒ La liste des instruments à stériliser prendra le plus de temps mais une fois établie elle n'est modifiée que lors de l'achat de nouveaux matériels à rajouter ou de matériels à supprimer pour mise au rebut
- ⇒ Création du cycle + Collage des étiquettes : 5 à 6 minutes
- ⇒ Traçabilité en fiche patient : moins de 30 secondes par patient